



COMPONENTES

Confie e use!

CATALOGO RP

2026



COMPONENTES

Confie e use!

Missão, visão e valores



Desenvolver e entregar soluções de qualidade para a implantodontia e o fluxo digital, contribuindo para o sucesso de nossos clientes e parceiros.



Ser referência em soluções para implantodontia e odontologia digital, reconhecida pela qualidade, inovação, confiança e capacidade de evoluir junto com nossos clientes.



Ética e transparência
Respeito às pessoas
Qualidade sem concessões
Inovação e melhoria contínua
Compromisso com o cliente
Trabalho, disciplina e determinação

Quem somos

Há mais de **20 anos**, a **RP Componentes** é referência em componentes para próteses sobre implantes. Cada componente é desenvolvido com características de acoplamento precisas, garantindo uma conexão segura e estável com os mais diversos sistemas de implantes do mercado. Para assegurar nossa eficácia e qualidade, todos os nossos componentes passam por rigorosos testes práticos, mecânicos e biológicos comprovando a resistência e a estabilidade necessárias para desempenhar com excelência a função a que se destinam.

E o mais importante, todos os produtos fabricados pela **RP Componentes** são registrados e liberados pela **ANVISA**, oferecendo total confiança para profissionais e pacientes.



MARCA	ÂNG.	MODELO	PÁG.
Neodent®	16°	GM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0/6.0	13
Conexão®	16°	Flash Gold GMF	13
IntraOss®	16°	Grand Oss	13
Plenum®	16°	Morsefit MF	13
Singular®	16°	GMC	13
Neodent®	11.5°	Neodent CM 3.5/4.3/5.0	25
BioConect®	11.5°	BioCM 3.5/4.3/5.0	25
Conexão®	11.5°	CM Flash Fit/Torq Fit e Flex Gold Fit	25
DentFix®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.3/5.0	25
DentoFlex®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.25/5.0	25
DSP®	11.5°	CM 3.5/3.75/3.8/4.0/4.3/4.5/5.0	25
INP®	11.5°	CM 3.3/3.8/4.3/5.0	25
IntraOss®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.3	25
Kopp®	11.5°	Morse Screw	25
Plenum®	11.5°	Unifit UF	25
Pross®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	25
Signo Vinces®	11.5°	Ancor	25
SIN®	11.5°	CM 3.5/4.3/5.0	25
Singular®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	25
Systhex®	11.5°	CM 3.5/4.3/5.0 Avantt	25
Implacil de Bortoli®	11.5°	CM 3.5/4.3/5.0	38
SIN® SW	16°	CM 3.8/4.5/5.5	47
Straumann® NC	30°	NC 3.3	55
Derig®	30°	CMI 3.3	55


MARCA	ÂNG.	MODELO	PÁG.
Straumann® RC	30°	RC 4.1	65
Straumann® RB/WB	14°	RB/WB 3.5 A 6.5	75
Straumann® RN	14°	RN 4.8	84
Nobel Biocare® CC	24°	CM 3.0 CC	94
Nobel Biocare® NP	24°	CM 3.5 NP	97
Conexão®	24°	CM 3.5/3.75/4.0	97
Derig®	24°	CMH 3.3/3.5/3.75/4.3	97
Nobel Biocare® RP	24°	CM 4.3/5.0 RP	105
Titaniumfix®	22°	CM 3.5/4.0	113
Signo Vinces®	22°	CM 3.3/3.8/4.5/4.6	113
Astra Tech®	22°	CM 3.5/4.0	113
Medens®	10°	CM 3.5/4.0/5.0	120
Bio®	10°	CM 3.5/4.0/5.0	120
Systhex® Attract	10°	CM 3.5/4.0/5.0	120
Osstem®	22°	CM 3.5/4.0	128
Mis® CI	12°	CM 3.75/4.2	134



MARCA	MODELO	PÁG.
Neodent®	Plataforma estreita NP	143
BioConect®	Plataforma estreita NP	143
Bionnovation®	Plataforma estreita NP	143
Conexão®	Plataforma estreita NP	143
DentFix®	Plataforma estreita NP	143
DSP®	Plataforma estreita NP	143
Implus®	Plataforma estreita NP	143
INP®	Plataforma estreita NP	143
Pross®	Plataforma estreita NP	143
Restore®	Plataforma estreita NP	143
Singular®	Plataforma estreita NP	143
Systhex®	Plataforma estreita NP	143
Implacil de Bortoli®	Plataforma estreita NP	152
Signo Vines®	Plataforma estreita NP	152
3i®	Plataforma estreita NP	159
SIN®	Plataforma estreita NP	159
IlIntraOss®	Plataforma estreita NP	159
SIN®	Plataforma regular slim	161
All Prime®	Plataforma regular slim	161
Dentoflex®	Plataforma regular slim	161
Implalife®	Plataforma regular slim	161
Medens®	Plataforma regular slim	161
Titanium Fix®	Plataforma regular slim	161
Neodent®	Plataforma regular	168
3i®	Plataforma regular	168

MARCA	MODELO	PÁG.
All Prime®	Plataforma regular	168
BioConect®	Plataforma regular	168
Bionnovation®	Plataforma regular	168
DentFix®	Plataforma regular	168
Dentoflex®	Plataforma regular	168
Derig®	Plataforma regular	168
DSP®	Plataforma regular	168
FGM® – VEZZA	Plataforma regular	168
Implacil de Bortoli®	Plataforma regular	168
Implalife®	Plataforma regular	168
Implus®	Plataforma regular	168
INP®	Plataforma regular	168
IntraOss®	Plataforma regular	168
Kopp®	Plataforma regular	168
Medens®	Plataforma regular	168
Nobel®	Plataforma regular	168
Pi Branemark®	Plataforma regular	168
Pross®	Plataforma regular	168
Signo Vinces®	Plataforma regular	168
SIN®	Plataforma regular	168
Singular®	Plataforma regular	168
Systhex®	Plataforma regular	168
Titanium Fix®	Plataforma regular	168


MARCA	MODELO	PÁG.
Neodent®	Plataforma larga WP	177
Systhex®	Plataforma larga WP	177
Signo Vinces®	Plataforma larga WP	177
INP®	Plataforma larga WP	177
Bio Implantes®	Plataforma larga WP	177

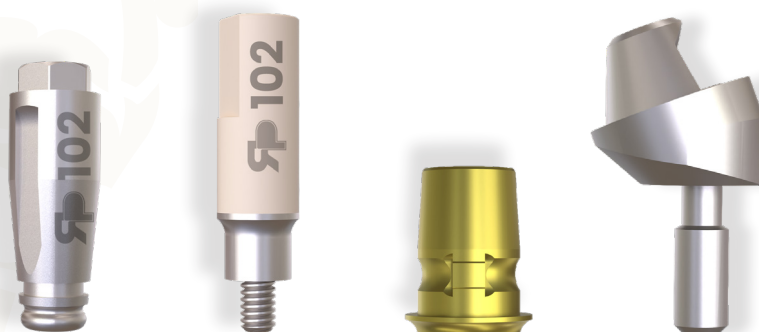

MARCA	MODELO	PÁG.
Conexão®	Sistema HI 3.75/4.0/4.3/5.0	180
IntraOss®	Sistema HI 3.8/4.5/5.5	180
SIN®	Sistema HI 3.8/4.5/5.0	180
Systhex®	Sistema HI 3.75/4.0/4.3/5.0	180
Dentoflex®	Sistema HI 3.5 A 5.0	187
Implacil de Bortoli®	HI 3.3/3.5 e HI Maestro 3.5/4.0/5.0	194
Implacil de Bortoli®	Sistema HI 3.75/4.0/4.3/4.75/5.0	194
INP® Conus	Sistema HI 3.5/4.0	194
MIS®	Sistema HI 3.3	203
MIS® Seven	Sistema HI 3.7/4.2	210
DSP®	Sistema HI 3.7/4.2	210
Titanium Fix®	Sistema HI 3.75/4.0	218



MODELO	PÁG.
Overdenture	225
Uclafix	227
Chave digital	228
Chave torquímetro	229
Instrumentais	230
Kits Chaves Multimarcas	232
Kit Protético Plus	233
Kit de Identificação CM	234
Kit RP para Conversão	235

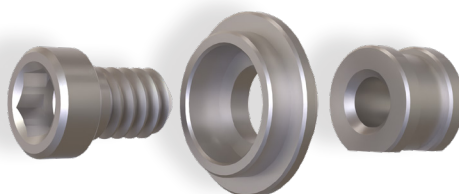

Referência de Produtos

As referências de produtos de uma empresa são essenciais para ajudar os consumidores a entender e se conectar com os produtos oferecidos.

A **RP Componentes** possui em sua linha referências que seguem uma lógica para facilitar e agilizar o entendimento, abaixo você confere um exemplo de código completo e sua composição

P 6 0 0 1 0 5 C



+



+



+



Os três primeiros dígitos se referem ao tipo de produto e em alguns casos a adição da letra **"P"** no início sinaliza que aquele item acompanha parafuso.

PARAFUSO

P // Acompanha parafuso

TIPO DE PRODUTO

- 100 // Análogo
- 200 // Transfer
- 300 // Cicatrizador
- 400 // Pilar Provisório
- 500 // Pilar Definitivo
- 600 // Ucla Plástica
- 700 // Ucla Base Crco
- 800 // Mini Pilar
- 900 // Pilar O'Ring





Após o tipo de produto, os três dígitos seguintes sinalizam o sistema de implante.

FAMÍLIA DE PRODUTO

712 — Cone Morse 16° SIN	208 — HI IMPLACIL MAESTRO
720 — Cone Morse 16° GM	209 — HI IMPLACIL 3.75 a 5.0
703 — Cone Morse 11.5° NEO	204 — HI DENTOFLEX
714 — Cone Morse 11.5° IMPLACIL	316 — HI SIN / CONEXÃO
701 — Cone Morse 22° TITANIUM FIX	799 — HI MIS 3.3
702 — Cone Morse 22° OSSTEM	800 — HI MIS 3.7/4.2
319 — Cone Morse 3.0 NOBEL	113 — HI TITANIUM FIX
705 — Cone Morse 24° CONEXÃO / NOBEL NP	102 — HE NP NEO / CONEXÃO
321 — Cone Morse 4.3 NOBEL RP	103 — HE NP IMPLACIL
750 — Cone Morse STR NC	108 — HE REGULAR SLIM
755 — Cone Morse STR RC	105 — HE REGULAR
730 — Cone Morse STR RN	110 — HE WP NEO
790 — Cone Morse STR BLX	005 — MINI PILAR
801 — Cone Morse 12° MIS	007 — PILAR GT
716 — Cone Morse 10° MEDENS / BIO	008 — PILAR GM
208 — HI IMPLACIL 3.3/3.5	010 — MICRO PILAR



O último ou dois últimos dígitos em alguns casos, fazem referência à uma característica do componente. Para os pilares tem a indicação se o componentes é com ou sem travamento. No transfer temos a indicação de moldeira aberta ou fechada. Para cicatrizadores e mini pilares temos a indicação da altura da cinta.

COMPLEMENTOS DE REFERÊNCIA

● C — Com travamento anti-rotacional	A — Moldeira aberta	A — Cinta 1mm ou 0.8mm para alguns sistemas	D — Cinta 4mm ou 3.5mm para alguns sistemas
○ S — Sem travamento rotacional	B — Moldeira fechada	B — Cinta 2mm ou 1.5mm para alguns sistemas	E — Cinta 5mm ou 4.5mm para alguns sistemas
		C — Cinta 3mm ou 2.5mm para alguns sistemas	F — Cinta 6mm ou 5.5mm para alguns sistemas

Sistema Cone Morse



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°

COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H0.8mm
H1.5mm
H2.5mm
H3.5mm
H4.5mm
H5.5mm

CÓDIGO

Ø3.3

CÓDIGO

Ø4.5

300720A

300721A

300720B

300721B

300720C

300721C

300720D

300721D

300720E

300721E

300720F

300721F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200720A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200720B



ANÁLOGO

CÓDIGO



Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO


- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO


H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm

CÓDIGO

CÓDIGO

P400720CA ● P400720SA ○
P400720CB ● P400720SB ○
P400720CC ● P400720SC ○
P400720CD ● P400720SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA


H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm

CÓDIGO

CÓDIGO

P700720CA ● P700720SA ○
P700720CB ● P700720SB ○
P700720CC ● P700720SC ○
P700720CD ● P700720SD ○

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm
H 5.5mm

CÓDIGO

P500720A ●
P500720B ●
P500720C ●
P500720D ●
P500720E ●
P500720F ●



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16HCAC

Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200720




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100720

PROVISÓRIO E CERÂMICA




PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 0.8mm
H 0.8mm
H 1.5mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 3.5mm

P1720CSA ●
P1720SSA ○
P1720CSB ●
P1720SSB ○
P1720CSC ●
P1720SSC ○
P1720CSD ●
P1720SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.8mm
H 0.8mm
H 1.5mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 3.5mm

P1720CLA ●
P1720SLA ○
P1720CLB ●
P1720SLB ○
P1720CLC ●
P1720SLC ○
P1720CLD ●
P1720SLD ○



Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.8mm Reto
H 1.5mm Reto
H 2.5mm Reto
H 3.5mm Reto
H 4.5mm Reto
H 5.5mm Reto

800720A ○
800720B ○
800720C ○
800720D ○
800720E ○
800720F ○

H 1.5mm 17°
H 2.5mm 17°
H 3.5mm 17°

80720BG ●
80720CG ●
80720DG ●

H 1.5mm 30°
H 2.5mm 30°
H 3.5mm 30°

80720BH ●
80720CH ●
80720DH ●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Singular® GMC
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136



Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Singular® GMC
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF



Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

Cód.
720

Cone Morse 16°


UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

- P1005A ☐
- P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU




PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

PRÓTESE MÚLTIPLA

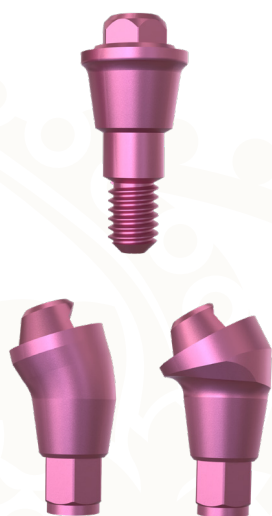

MICRO PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.8mm	Reto	801011A	☐
H 1.5mm	Reto	801011B	☐
H 2.5mm	Reto	801011C	☐
H 3.5mm	Reto	801011D	☐
H 4.5mm	Reto	801011E	☐
H 5.5mm	Reto	801011F	☐
H 1.5mm	17°	81011BG	☒
H 2.5mm	17°	81011CG	☒
H 3.5mm	17°	81011DG	☒
H 1.5mm	30°	81011BH	☒
H 2.5mm	30°	81011CH	☒
H 3.5mm	30°	81011DH	☒

LEGENDA



Hexagonal



Dinâmica



Rotacional



Antirrotacional



Cód.
720

Cone Morse 16°


UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°



COMPONENTES SOBRE O MICRO PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301010



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201010A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201010B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101010

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701010 ☐



UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

UNITÁRIA PARAFUSADA



PILAR GM RP

CÓDIGO

- H 0.8mm
- H 1.5mm
- H 2.5mm
- H 3.5mm
- H 4.5mm
- H 5.5mm

- 801008A
- 801008B
- 801008C
- 801008D
- 801008E
- 801008F

COMPONENTES SOBRE O PILAR GM



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301008



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201008B



Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

16°



ANÁLOGO

CÓDIGO

101008

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401008C ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701008C ○



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20FGMEX

UNITÁRIA CIMENTADA



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
H 0.8mm	50701DA	50701FA	50702DA	50702FA
H 1.5mm	50701DB	50701FB	50702DB	50702FB
H 2.5mm	50701DC	50701FC	50702DC	50702FC
H 3.5mm	50701DD	50701FD	50702DD	50702FD
H 4.5mm	50701DE	50701FE	50702DE	50702FE
H 5.5mm	50701DF	50701FF	50702DF	50702FF



Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent® GM
- » Conexão® Flash Gold GMF
- » IntraOss® Grand Oss
- » Plenum® Morsefit MF
- » Singular® GMC


INDEX HEXAGONAL
2.0mm



ROSCA M1.6



COMPONENTES SOBRE O PILAR UNIVERSAL



POSTE TRANSFER DO PILAR UNIVERSAL

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
200708D	200708F	200709D	200709F



ANÁLOGO

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
100708D	100708F	100709D	100709F

PROVISÓRIO



POSTE PROVISÓRIO DO PILAR UNIVERSAL

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
400708D	400708F	400709D	400709F

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA DO PILAR UNIVERSAL

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
600708D	600708F	600709D	600709F



SOLUÇÕES PARA
**PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.8

11.5°



COMPONENTES ANALÓGICOS



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301703

CICATRIZADOR

CÓDIGO

Ø3.3

CÓDIGO

Ø4.5

H 0.8mm

300703A

300704A

H 1.5mm

300703B

300704B

H 2.5mm

300703C

300704C

H 3.5mm

300703D

300704D

H 4.5mm

300703E

300704E

H 5.5mm

300703F

300704F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200703A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200703B



Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

11.5°

ROSCA M1.8




ANÁLOGO

CÓDIGO

100703

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm

CÓDIGO

CÓDIGO

P400703CA ● P400703SA ○
P400703CB ● P400703SB ○
P400703CC ● P400703SC ○
P400703CD ● P400703SD ○
P400703CE ● P400703SE ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm

CÓDIGO

CÓDIGO

P700703CA ● P700703SA ○
P700703CB ● P700703SB ○
P700703CC ● P700703SC ○
P700703CD ● P700703SD ○
P700703CE ● P700703SE ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18HND



Cód.
703

Cone Morse 11.5°


UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vines® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.8

11.5°



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200703




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100703

PROVISÓRIO E CERÂMICA



4mm

PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 0.8mm

P1703CSA ●

H 0.8mm

P1703SSA ○

H 1.5mm

P1703CSB ●

H 1.5mm

P1703SSB ○

H 2.5mm

P1703CSC ●

H 2.5mm


P1703SSC ○

H 3.5mm

P1703CSD ●

H 3.5mm

P1703SSD ○



5mm

PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.8mm

P1703CLA ●

H 0.8mm

P1703SLA ○

H 1.5mm

P1703CLB ●

H 1.5mm

P1703SLB ○

H 2.5mm

P1703CLC ●

H 2.5mm

P1703SLC ○

H 3.5mm

P1703CLD ●

H 3.5mm

P1703SLD ○

LEGENDA



Hexagonal



Rotacional



Antirrotacional



Cód.
703

Cone Morse 11.5°


UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.8

11.5°



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.8mm Reto
H 1.5mm Reto
H 2.5mm Reto
H 3.5mm Reto
H 4.5mm Reto
H 5.5mm Reto

800703A ○
800703B ○
800703C ○
800703D ○
800703E ○
800703F ○

H 1.5mm 17°
H 2.5mm 17°
H 3.5mm 17°

80703BG ●
80703CG ●
80703DG ●

H 1.5mm 30°
H 2.5mm 30°
H 3.5mm 30°

80703CH ●
80703BH ●
80703DH ●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

11.5°

ROSCA M1.8




ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136



UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.8

11.5°

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005



Cód.
703

Cone Morse 11.5°


UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

11.5°

ROSCA M1.8



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

- P1005A ☐
- P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

PRÓTESE MÚLTIPLA



MICRO PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.8mm	Reto	801010A	☐
H 1.5mm	Reto	801010B	☐
H 2.5mm	Reto	801010C	☐
H 3.5mm	Reto	801010D	☐
H 4.5mm	Reto	801010E	☐
H 5.5mm	Reto	801010F	☐
H 1.5mm	17°	81010BG	☒
H 2.5mm	17°	81010CG	☒
H 3.5mm	17°	81010DG	☒
H 1.5mm	30°	81010BH	☒
H 2.5mm	30°	81010CH	☒
H 3.5mm	30°	81010DH	☒



Cód.
703

Cone Morse 11.5°


UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.8

11.5°



COMPONENTES SOBRE O MICRO PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301010



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201010A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201010B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101010

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701010 ☐



Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vines® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.8

11.5°



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

UNITÁRIA PARAFUSADA



PILAR GT

CÓDIGO

- H 0.8mm
- H 1.5mm
- H 2.5mm
- H 3.5mm
- H 4.5mm
- H 5.5mm

- 801007A
- 801007B
- 801007C
- 801007D
- 801007E
- 801007F

COMPONENTES SOBRE O PILAR GT



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301007



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201007A



Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vines® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

11.5°

ROSCA M1.8



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201007B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101007

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401007C

P401007S

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601007C

P601007S



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701007C

P701007S



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20BTI



UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®


INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.8

11.5°

UNITÁRIA CIMENTADA

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
H 0.8mm	50708DA	50708FA	50709DA	50709FA
H 1.5mm	50708DB	50708FB	50709DB	50709FB
H 2.5mm	50708DC	50708FC	50709DC	50709FC
H 3.5mm	50708DD	50708FD	50709DD	50709FD
H 4.5mm	50708DE	50708FE	50709DE	50709FE
H 5.5mm	50708DF	50708FF	50709DF	50709FF

COMPONENTES SOBRE O PILAR UNIVERSAL

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
POSTE TRANSFER DO PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	200708D	200708F	200709D	200709F



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
ANÁLOGO	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	100708D	100708F	100709D	100709F


PROVISÓRIO

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
POSTE PROVISÓRIO DO PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	400708D	400708F	400709D	400709F


UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vincés® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®

INDEX HEXAGONAL
2.0mm



ROSCA M1.8



FUNDIÇÃO



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
UCLA PLÁSTICA DO PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	600708D	600708F	600709D	600709F

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 0.8mm	900703A ○
H 1.5mm	900703B ○
H 2.5mm	900703C ○
H 3.5mm	900703D ○
H 4.5mm	900703E ○
H 5.5mm	900703F ○

MAIOR QUALIDADE E
PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)




COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

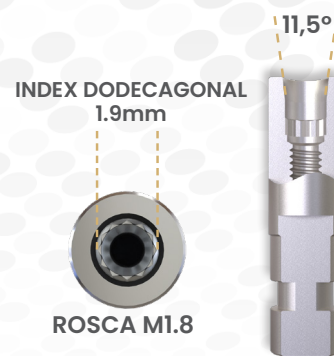

COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H0.8mm
H1.5mm
H2.5mm
H3.5mm
H4.5mm
H5.5mm

CÓDIGO

Ø3.3

CÓDIGO

Ø4.5

300703A	300704A
300703B	300704B
300703C	300704C
300703D	300704D
300703E	300704E
300703F	300704F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200714A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200714B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100714




Cód.
714


Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

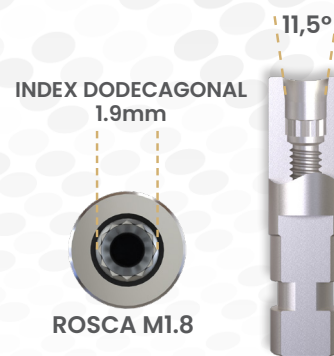

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm


CÓDIGO

P400714CA ●
P400714CB ●
P400714CC ●

CÓDIGO

P400714SA ○
P400714SB ○
P400714SC ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm

CÓDIGO

P700714CA ●
P700714CB ●
P700714CC ●

CÓDIGO

P700714SA ○
P700714SB ○
P700714SC ○



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18HSU




Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

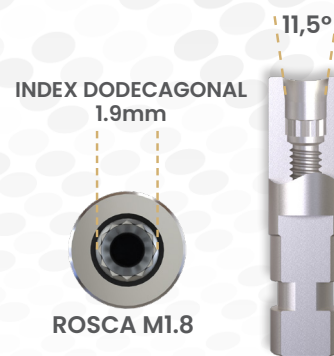

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200714




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100714


PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 0.8mm	P1714CSA ●
H 0.8mm	P1714SSA ○
H 1.5mm	P1714CSB ●
H 1.5mm	P1714SSB ○
H 2.5mm	P1714CSC ●
H 2.5mm	P1714SSC ○
H 3.5mm	P1714CSD ●
H 3.5mm	P1714SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.8mm	P1714CLA ●
H 0.8mm	P1714SLA ○
H 1.5mm	P1714CLB ●
H 1.5mm	P1714SLB ○
H 2.5mm	P1714CLC ●
H 2.5mm	P1714SLC ○
H 3.5mm	P1714CLD ●
H 3.5mm	P1714SLD ○




Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

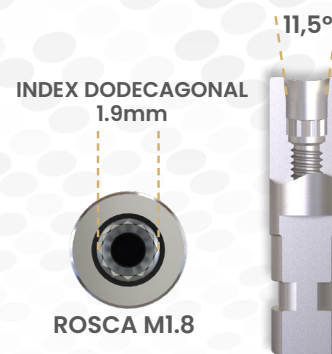

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.8mm	Reto	800703A	○
H 1.5mm	Reto	800703B	○
H 2.5mm	Reto	800703C	○
H 3.5mm	Reto	800703D	○
H 4.5mm	Reto	800703E	○
H 5.5mm	Reto	800703F	○
H 1.5mm	17°	80714BG	●
H 2.5mm	17°	80714CG	●
H 3.5mm	17°	80714DG	●
H 1.5mm	30°	80714CH	●
H 2.5mm	30°	80714BH	●
H 3.5mm	30°	80714DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

INDEX DODECAGONAL
1.9mm

ROSCA M1.8

11,5°



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐




Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

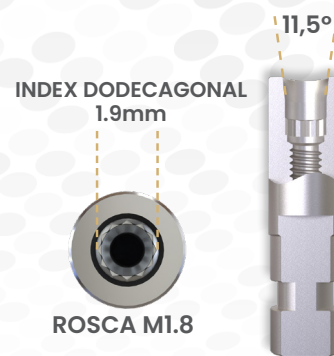

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO


D100005

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

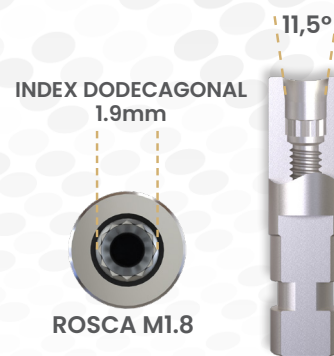

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐
P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO


M14DI

UNITÁRIA CIMENTADA



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
H 0.8mm	50708DA	50708FA	50709DA	50709FA
H 1.5mm	50708DB	50708FB	50709DB	50709FB
H 2.5mm	50708DC	50708FC	50709DC	50709FC
H 3.5mm	50708DD	50708FD	50709DD	50709FD
H 4.5mm	50708DE	50708FE	50709DE	50709FE
H 5.5mm	50708DF	50708FF	50709DF	50709FF

COMPONENTES SOBRE O PILAR UNIVERSAL



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
POSTE TRANSFER DO PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	200708D	200708F	200709D	200709F




Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®

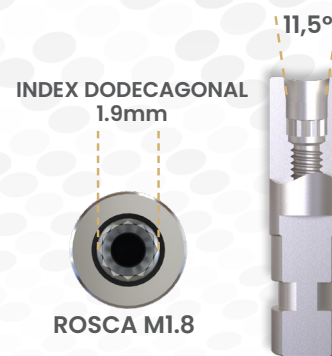

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
ANÁLOGO	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	100708D	100708F	100709D	100709F

PROVISÓRIO



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
POSTE PROVISÓRIO DO PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	400708D	400708F	400709D	400709F

FUNDIÇÃO



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
UCLA PLÁSTICA DO PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	600708D	600708F	600709D	600709F


SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 0.8mm	900703A ○
H 1.5mm	900703B ○
H 2.5mm	900703C ○
H 3.5mm	900703D ○
H 4.5mm	900703E ○
H 5.5mm	900703F ○





LINHA COMPLETA **FLUXO DIGITAL**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
712

Cone Morse 16°


UTILIZAÇÃO

» SIN® SW

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

16°

ROSCA M1.6



COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

Ø3.5

CÓDIGO

Ø4.5

300712B

300713B

300712C

300713C

300712D

300713D

300712E

300713E

300712F

300713F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200712A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200712B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100712



Cód.
712

Cone Morse 16°


UTILIZAÇÃO

» SIN® SW

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

16°

ROSCA M1.6



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

P400712CA ●
P400712CB ●
P400712CC ●
P400712CD ●

CÓDIGO

P400712SA ○
P400712SB ○
P400712SC ○
P400712SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

P700712CA ●
P700712CB ●
P700712CC ●
P700712CD ●

CÓDIGO

P700712SA ○
P700712SB ○
P700712SC ○
P700712SD ○

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

P500712A ●
P500712B ●
P500712C ●
P500712D ●
P500712E ●
P500712F ●

20
N.cm



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16HSI



Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200712




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100712

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm

P1712CSA ●

H 1mm

P1712SSA ○

H 2mm

P1712CSB ●

H 2mm

P1712SSB ○

H 3mm

P1712CSC ●

H 3mm


P1712SSC ○

H 4mm

P1712CSD ●

H 4mm

P1712SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm

P1712CLA ●

H 1mm

P1712SLA ○

H 2mm

P1712CLB ●

H 2mm

P1712SLB ○

H 3mm

P1712CLC ●

H 3mm

P1712SLC ○

H 4mm

P1712CLD ●

H 4mm

P1712SLD ○



Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW

INDEX HEXAGONAL
2.0mm



ROSCA M1.6



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800712A	○
H 2mm	Reto	800712B	○
H 3mm	Reto	800712C	○
H 4mm	Reto	800712D	○
H 5mm	Reto	800712E	○
H 6mm	Reto	800712F	○
H 2mm	17°	80712BG	●
H 3mm	17°	80712CG	●
H 4mm	17°	80712DG	●
H 2mm	30°	80712BH	●
H 3mm	30°	80712CH	●
H 4mm	30°	80712DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

16°

ROSCA M1.6



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136



Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

16°

ROSCA M1.6

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005



Cód.
712

Cone Morse 16°


UTILIZAÇÃO

» SIN® SW

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

16°

ROSCA M1.6



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐
P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O'RING

CÓDIGO

H 0.8mm	900712A ☐
H 1.5mm	900712B ☐
H 2.5mm	900712C ☐
H 3.5mm	900712D ☐
H 4.5mm	900712E ☐
H 5.5mm	900712F ☐

A MAIOR DIVERSIDADE
DE **COMPONENTES**
PARA **PRÓTESES**
SOBRE IMPLANTES
DO PAÍS



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
750

Cone Morse 30°


UTILIZAÇÃO

- » Straumann® NC 3.3
- » Derig® CMI 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



COMPONENTES ANALÓGICOS



3.6 mm



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301750

CICATRIZADOR

CÓDIGO

H 2mm

300750B

H 3.5mm

300750C

H 5mm

300750E

H 6mm

300750F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200750A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200750B



Cód.
750

Cone Morse 30°


UTILIZAÇÃO

- » Straumann® NC 3.3
- » Derig® CMI 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6




ANÁLOGO

CÓDIGO

100750

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

CÓDIGO

H 2mm

P400750CB  P400750SB 

H 3mm

P400750CC  P400750SC 

H 4mm

P400750CD  P400750SD 

H 5mm

P400750CE  P400750SE 

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

CÓDIGO

H 2mm

P700750CB  P700750SB 

H 3mm

P700750CC  P700750SC 

H 4mm

P700750CD  P700750SD 

H 5mm

P700750CE  P700750SE 



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16TNC

Cód.
750

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

- » Straumann® NC 3.3
- » Derig® CMI 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO


D200750

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100750


PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE NC SEM PERFIL

CÓDIGO


H 1mm	P1750CSA ●
H 1mm	P1750SSA ○
H 2mm	P1750CSB ●
H 2mm	P1750SSB ○
H 3mm	P1750CSC ●
H 3mm	P1750SSC ○



PILAR INTERFACE NC COM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm	P1750CLA ●
H 1mm	P1750SLA ○
H 2mm	P1750CLB ●
H 2mm	P1750SLB ○
H 3mm	P1750CLC ●
H 3mm	P1750SLC ○



PILAR INTERFACE VB NC

CÓDIGO

H 1mm	PVB750A ●
H 2mm	PVB750B ●
H 3mm	PVB750C ●

Cód.
750

Cone Morse 30°


UTILIZAÇÃO

- » Straumann® NC 3.3
- » Derig® CMI 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto
H 2mm	Reto
H 3mm	Reto
H 4mm	Reto
H 5mm	Reto
H 6mm	Reto

800750A	○
800750B	○
800750C	○
800750D	○
800750E	○
800750F	○



H 2mm	17°
H 3mm	17°
H 4mm	17°

80750BG	●
80750CG	●
80750DG	●

H 3mm	30°
H 4mm	30°

80750CH	●
80750DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



Cód.
750

Cone Morse 30°


UTILIZAÇÃO

- » Straumann® NC 3.3
- » Derig® CMI 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐



Cód.
750

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

- » Straumann® NC 3.3
- » Derig® CMI 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E 

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



Cód.
750

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

- » Straumann® NC 3.3
- » Derig® CMI 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O'RING

CÓDIGO

H 2mm

900750B ☐

H 3.5mm

900750C ☐

H 5mm

900750E ☐

H 6mm

900750F ☐



Cód.
750

Cone Morse 30°


UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



PRÓTESE PARAFUSADA SRA

Ø3.5

Ø4.6



PILAR SRA

H 1mm
H 2.5mm
H 4mm

CÓDIGO

Ø3.5

CÓDIGO

Ø4.6

800751A

800752A

800751B

800752B

800751C

800752C

COMPONENTES SOBRE O PILAR SRA



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301751



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA (SRA)

CÓDIGO

Ø3.5

CÓDIGO

Ø4.6

200751A

200752A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA (SRA)

CÓDIGO

Ø3.5

CÓDIGO

Ø4.6

200751B

200752B



Cód.
750

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3

INDEX NC



ROSCA M1.6



Ø3.5

Ø4.6



ANÁLOGO AP (SRA)

CÓDIGO

CÓDIGO

Ø3.5

Ø4.6

100751

100752

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO AP (SRA)

CÓDIGO

CÓDIGO

Ø3.5

Ø4.6

P400751C



P400752C



P400751S



P400752S



FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

CÓDIGO

Ø3.5

Ø4.6

P600751C



P600752C



P600751S



P600752S



PARAFUSO

M14UMU

SOLUÇÕES PARA
**PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC



ROSCA M1.6



COMPONENTES ANALÓGICOS



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301755



CICATRIZADOR

CÓDIGO

Ø4.5

CÓDIGO

Ø5.0

H 2mm

300755B

300756B

H 3mm

300755C

300756C

H 4mm

300755D

300756D

H 5mm

300755E

300756E

H 6mm

300755F

300756F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200755A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200755B



Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC

ROSCA M1.6

30°




ANÁLOGO

CÓDIGO

100755

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

CÓDIGO

H 2mm

P400755CB  P400755SB 

H 3mm

P400755CC  P400755SC 


H 4mm

P400755CD  P400755SD 

H 5mm

P400755CE  P400755SE 

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

CÓDIGO

H 2mm

P700755CB  P700755SB 

H 3mm

P700755CC  P700755SC 

H 4mm

P700755CD  P700755SD 

H 5mm

P700755CE  P700755SE 



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16TRC

Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC

ROSCA M1.6

30°

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200755




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100755

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm

P1755CSA ●

H 1mm

P1755SSA ○

H 2mm

P1755CSB ●

H 2mm


P1755SSB ○

H 3mm

P1755CSC ●

H 3mm

P1755SSC ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm

P1755CLA ●

H 1mm

P1755SLA ○

H 2mm

P1755CLB ●

H 2mm

P1755SLB ○

H 3mm

P1755CLC ●

H 3mm

P1755SLC ○



PILAR INTERFACE VB RC

CÓDIGO

H 1mm

PVB755A ●

H 2mm

PVB755B ●

H 3mm

PVB755C ●

Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC

ROSCA M1.6

30°

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800755A	○
H 2mm	Reto	800755B	○
H 3mm	Reto	800755C	○
H 4mm	Reto	800755D	○
H 5mm	Reto	800755E	○
H 6mm	Reto	800755F	○
H 2mm	17°	80755BG	●
H 3mm	17°	80755CG	●
H 4mm	17°	80755DG	●
H 3mm	30°	80755CH	●
H 4mm	30°	80755DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC

ROSCA M1.6

30°



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐



Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC

ROSCA M1.6

30°

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E 

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC

ROSCA M1.6

30°



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O'RING

CÓDIGO

H 2mm

900755B ☐

H 3.5mm

900755C ☐

H 5mm

900755E ☐

H 6mm

900755F ☐



Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC

ROSCA M1.6

30°



PRÓTESE PARAFUSADA SRA

Ø4.6



PILAR SRA

H 1mm
H 2.5mm
H 4mm

CÓDIGO

Ø4.6

800756A

800756B

800756C

COMPONENTES SOBRE O PILAR SRA



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301752



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA (SRA)

CÓDIGO

Ø4.6

200752A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA (SRA)

CÓDIGO

Ø4.6

200752B



ANÁLOGO

CÓDIGO

Ø4.6

100752



Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1

INDEX RC



ROSCA M1.6



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO AP (SRA)

CÓDIGO

Ø3.5

CÓDIGO

Ø4.6

P400751C 

P400752C 

P400751S 

P400752S 

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P600752C 

P600752S 



PARAFUSO

CÓDIGO

M14UMU

MAIOR QUALIDADE E
PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB

INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°

COMPONENTES ANALÓGICOS



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
CICATRIZADOR	Ø3.8 x 2mm	Ø3.8 x 4mm	Ø4.5 x 2mm	Ø4.5 x 4mm
H 1.5mm	30790BB	30790DB	30791BB	30791DB
H 2.5mm	30790BC	30790DC	30791BC	30791DC
H 3.5mm	30790BD	30790DD	30791BD	30791DD

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200790A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200790B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100790



Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB

INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°



FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm

CÓDIGO

P700790CA ●
P700790CB ●
P700790CC ●
P700790CD ●

CÓDIGO

P700790SA ○
P700790SB ○
P700790SC ○
P700790SD ○

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

H 2.5mm

CÓDIGO

P500790B ●



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16HCOC

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200790

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100790

Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB


INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°



PROVISÓRIO E CERÂMICA




PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 0.7mm
H 0.7mm
H 1.5mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 3.5mm

P1790CSA ●
P1790SSA ○
P1790CSB ●
P1790SSB ○
P1790CSC ●
P1790SSC ○
P1790CSD ●
P1790SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.7mm
H 0.7mm
H 1.5mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 3.5mm

P1790CLA ●
P1790SLA ○
P1790CLB ●
P1790SLB ○
P1790CLC ●
P1790SLC ○
P1790CLD ●
P1790SLD ○

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1.5mm Reto
H 2.5mm Reto
H 3.5mm Reto
H 4.5mm Reto
H 5.5mm Reto
H 6.5mm Reto

800790A ○
800790B ○
800790C ○
800790D ○
800790E ○
800790F ○

Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB

INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB

INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°



FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB

INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB

INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°



PRÓTESE PARAFUSADA SRA

Ø4.6



PILAR SRA

CÓDIGO

H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm

800791A ☐
800791B ☐
800791C ☐
800791D ☐

COMPONENTES SOBRE O PILAR SRA



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301752



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA (SRA)

CÓDIGO

Ø4.6

200752A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA (SRA)

CÓDIGO

Ø4.6

200752B



Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB

INDEX HEXALOBULAR

ROSCA M1.6

14°

Ø4.6



ANÁLOGO AP (SRA)

CÓDIGO

Ø4.6

100752

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO AP (SRA)

CÓDIGO

Ø4.6

P400752C 

P400752S 

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

Ø4.6


P600752C 

P600752S 



PARAFUSO

M14UMU



LINHA COMPLETA

FLUXO

DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°

COMPONENTES ANALÓGICOS



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301730

5.5mm



CICATRIZADOR

CÓDIGO

H 2mm

300730B

H 3mm

300730C

H 4.5mm

300730D

H 6mm

300730F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200730A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200730B



Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°




ANÁLOGO

CÓDIGO

100730

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO


CÓDIGO

CÓDIGO

P400730C 

P400730S 

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

CÓDIGO

P700730C 

P700730S 



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20TRN

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200730



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100730

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE COM PERFIL


CÓDIGO

H 1mm

P1730CLA ●

H 1mm

P1730SLA ○



PILAR INTERFACE VB RN

CÓDIGO

H 1mm

PVB730A ●



PARAFUSO INTERFACE VB RN

CÓDIGO

M20TRNZ

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800730A	○
H 2mm	Reto	800730B	○
H 3mm	Reto	800730C	○
H 4mm	Reto	800730D	○
H 1.5mm	17°	80730BG	●
H 2.5mm	17°	80730CG	●
H 3.5mm	17°	80730DG	●
H 2.5mm	30°	80730CH	●
H 3.5mm	30°	80730DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐



Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E 

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O´RING

CÓDIGO

H 2mm

900730B ☐

H 3mm

900730C ☐

H 4.5mm

900730D ☐

H 6mm

900730F ☐



Cód.
730

Cone Morse 14°


UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°



PRÓTESE PARAFUSADA SYNOCTA®



PILAR SYNOCTA®

CÓDIGO

80730AP



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301731



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200731A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200731B



ANÁLOGO SYNOCTA®

CÓDIGO

100730AP



Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN

INDEX OCTOGONAL

ROSCA M2.0

14°



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P400731C 

P400731S 

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P60730CAP 

P60730SAP 



UCLA BASE METÁLICA SYNOCTA®

CÓDIGO

P700731C 

P700731S 



PARAFUSO

CÓDIGO

M20TST

A **MAIOR** DIVERSIDADE
DE **COMPONENTES**
PARA **PRÓTESES**
SOBRE IMPLANTES
DO PAÍS



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
319

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® CC

INDEX
HEXALOBULAR

ROSCA M1.4

24°




COMPONENTES ANALÓGICOS



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301319



CICATRIZADOR

CÓDIGO

Ø3.2

CÓDIGO

Ø3.8

H 2mm

300318B

300319B

H 3mm

300318C

300319C

H 4mm

300318D

300319D

H 5mm

300318E

300319E

H 6mm

300318F

300319F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200319A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200319B



Cód.
319

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® CC

INDEX
HEXALOBULAR

ROSCA M1.4

24°



ANÁLOGO

CÓDIGO

100319

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

CÓDIGO

P700319C 

P700319S 



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14UEB



SOLUÇÕES PARA
**PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
705

Cone Morse 24°


UTILIZAÇÃO

- » Nobel Biocare® NP
- » Conexão® Flash / Torq
- » Derig® CMH

INDEX HEXAGONAL
2.25mm

ROSCA M1.6

24°



COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H0.8mm
H1.5mm
H2.5mm
H3.5mm
H4.5mm
H5.5mm

CÓDIGO

Ø3.6

CÓDIGO

Ø4.5

300700A	300705A
300700B	300705B
300700C	300705C
300700D	300705D
300700E	300705E
300700F	300705F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200705A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200705B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100705



Cód.
705

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

- » Nobel Biocare® NP
- » Conexão® Flash / Torq
- » Derig® CMH

INDEX HEXAGONAL
2.25mm

ROSCA M1.6

24°

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm

CÓDIGO

CÓDIGO

P400705CB	P400705SB
P400705CC	P400705SC
P400705CD	P400705SD
P400705CE	P400705SE

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm

CÓDIGO

CÓDIGO

P700705CB	P700705SB
P700705CC	P700705SC
P700705CD	P700705SD
P700705CE	P700705SE

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 4.5mm

CÓDIGO

P500705A	
P500705B	
P500705C	
P500705D	



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16HCN



Cód.
705

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

- » Nobel Biocare® NP
- » Conexão® Flash / Torq
- » Derig® CMH



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200705




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100705

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

- H 1.5mm
- H 1.5mm
- H 2.5mm
- H 2.5mm
- H 3.5mm
- H 3.5mm

- P1705CSB ●
- P1705SSB ○
- P1705CSC ●
- P1705SSC ○
- P1705CSD ●
- P1705SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

- H 1.5mm
- H 1.5mm
- H 2.5mm
- H 2.5mm
- H 3.5mm
- H 3.5mm

- P1705CLB ●
- P1705SLB ○
- P1705CLC ●
- P1705SLC ○
- P1705CLD ●
- P1705SLD ○

LEGENDA



Hexagonal



Rotacional



Antirrotacional



Cód.
705

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

- » Nobel Biocare® NP
- » Conexão® Flash / Torq
- » Derig® CMH

INDEX HEXAGONAL
2.25mm

ROSCA M1.6

24°



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.8mm	Reto	800705A	○
H 1.5mm	Reto	800705B	○
H 2.5mm	Reto	800705C	○
H 3.5mm	Reto	800705D	○
H 4.5mm	Reto	800705E	○
H 5.5mm	Reto	800705F	○
H 2.5mm	17°	80705CG	●
H 3.5mm	17°	80705DG	●
H 3.5mm	30°	80705DH	●
H 4.5mm	30°	80705EH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



Cód.
705

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

- » Nobel Biocare® NP
- » Conexão® Flash / Torq
- » Derig® CMH



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136



Cód.
705

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

- » Nobel Biocare® NP
- » Conexão® Flash / Torq
- » Derig® CMH



Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

Cód.
705

Cone Morse 24°


UTILIZAÇÃO

- » Nobel Biocare® NP
- » Conexão® Flash / Torq
- » Derig® CMH

INDEX HEXAGONAL
2.25mm

ROSCA M1.6

24°



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ○
P1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O´RING

CÓDIGO

H 0.8mm	900705A ○
H 1.5mm	900705B ○
H 2.5mm	900705C ○
H 3.5mm	900705D ○
H 4.5mm	900705E ○
H 5.5mm	900705F ○



MAIOR QUALIDADE E
PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
321

Cone Morse 24°


UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP

INDEX HEXAGONAL
2.65mm

ROSCA M2.0

24°



COMPONENTES ANALÓGICOS



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301321



CICATRIZADOR

CÓDIGO

CÓDIGO

Ø3.6

Ø5.0

H 2mm

300321B

300322B

H 3mm

300321C

300322C

H 4mm

300321D

300322D

H 5mm

300321E

300322E

H 6mm

300321F

300322F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200321A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200321B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100321



Cód.
321


Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm

CÓDIGO

P40321CA ●
P40321CB ●
P40321CC ●
P40321CD ●

CÓDIGO

P40321SA ○
P40321SB ○
P40321SC ○
P40321SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm

CÓDIGO

P700321C ●
P700321CB ●
P700321CC ●
P700321CD ●

CÓDIGO

P700321S ○
P700321SB ○
P700321SC ○
P700321SD ○

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

H 0.8mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm

CÓDIGO

P500321A ●
P500321B ●
P500321C ●
P500321D ●



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20HEB



Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO


D200321

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100321

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 1.5mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 3.5mm

P1321CSB ●
P1321SSB ○
P1321CSC ●
P1321SSC ○
P1321CSD ●
P1321SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 1.5mm
H 1.5mm
H 2.5mm
H 2.5mm
H 3.5mm
H 3.5mm

P1321CLB ●
P1321SLB ○
P1321CLC ●
P1321SLC ○
P1321CLD ●
P1321SLD ○



Cód.
321

Cone Morse 24°


UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP

INDEX HEXAGONAL
2.65mm

ROSCA M2.0

24°



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.8mm	Reto	800321A	○
H 1.5mm	Reto	800321B	○
H 2.5mm	Reto	800321C	○
H 3.5mm	Reto	800321D	○
H 4.5mm	Reto	800321E	○
H 5.5mm	Reto	800321F	○
H 2.5mm	17°	80321CG	●
H 3.5mm	17°	80321DG	●
H 3.5mm	30°	80321DH	●
H 4.5mm	30°	80321EH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

Cód.
321

Cone Morse 24°


UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP

INDEX HEXAGONAL
2.65mm

ROSCA M2.0

24°



PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDAR

CÓDIGO

P401005E 

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP

INDEX HEXAGONAL
2.65mm

ROSCA M2.0

24°

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU




PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI





LINHA COMPLETA **FLUXO DIGITAL**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES


Confie e use!

Cód.
701

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

- » Titanium Fix®
- » Signo Vines® Infra / Compact / Duocon
- » Astra Tech®

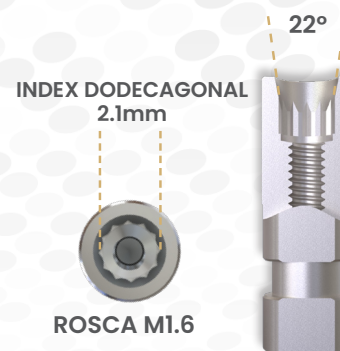

COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

300701B
300701C
300701D
300701E
300701F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200701A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200701B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100701



Cód.
701


Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

- » Titanium Fix®
- » Signo Vines® Infra / Compact / Duocon
- » Astra Tech®



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm


CÓDIGO

P400701CA ●
P400701CB ●
P400701CC ●
P400701CD ●

CÓDIGO

P400701SA ○
P400701SB ○
P400701SC ○
P400701SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

P700701CA ●
P700701CB ●
P700701CC ●
P700701CD ●

CÓDIGO

P700701SA ○
P700701SB ○
P700701SC ○
P700701SD ○

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

P500701A ●
P500701B ●
P500701C ●
P500701D ●



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16HAT




Cód.
701

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

- » Titanium Fix®
- » Signo Vines® Infra / Compact / Duocon
- » Astra Tech®

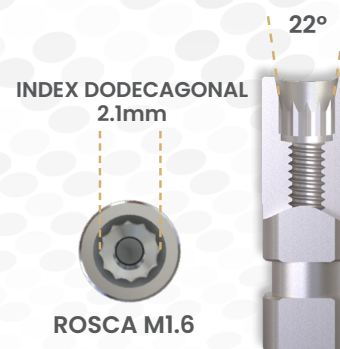

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200701




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100701

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm	P1701CSB	●
H 1mm	P1701SSB	○
H 2mm	P1701CSC	●
H 2mm	P1701SSC	○
H 3mm	P1701CSD	●
H 3mm	P1701SSD	○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm	P1701CLB	●
H 1mm	P1701SLB	○
H 2mm	P1701CLC	●
H 2mm	P1701SLC	○
H 3mm	P1701CLD	●
H 3mm	P1701SLD	○




Cód.
701

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

- » Titanium Fix®
- » Signo Vínces® Infra / Compact / Duocon
- » Astra Tech®

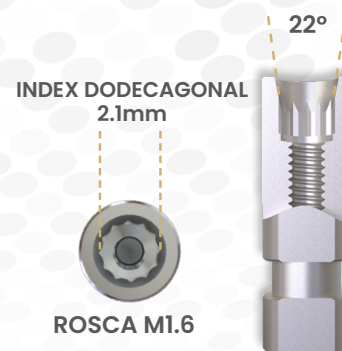

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800701A	○
H 2mm	Reto	800701B	○
H 3mm	Reto	800701C	○
H 4mm	Reto	800701D	○
H 5mm	Reto	800701E	○
H 6mm	Reto	800701F	○

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005



Cód.
701

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

- » Titanium Fix®
- » Signo Vines® Infra / Compact / Duocon
- » Astra Tech®



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136



Cód.
701


Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

- » Titanium Fix®
- » Signo Vincés® Infra / Compact / Duocon
- » Astra Tech®



Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136

PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU

PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐
P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



A **MAIOR** DIVERSIDADE
DE **COMPONENTES**
PARA **PRÓTESES**
SOBRE IMPLANTES
DO PAÍS



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

- » Medens®
- » Bio®
- » Systhex® Attract

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

10°



COMPONENTES ANALÓGICOS

5.5mm



CICATRIZADOR

H 0.7mm
H 1.5mm
H 3.0mm
H 4.5mm
H 6.0mm

CÓDIGO

300716A
300716B
300716C
300716D
300716E

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200716A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200716B




Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

- » Medens®
- » Bio®
- » Systhex® Attract

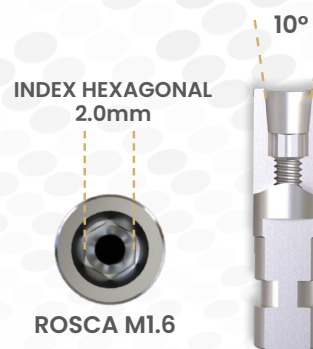

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



ANÁLOGO

CÓDIGO

100716

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 0.7mm
H 1.5mm
H 3.0mm
H 4.5mm
H 6.0mm

CÓDIGO

P400716CA ●
P400716CB ●
P400716CC ●
P400716CD ●
P400716CE ●

CÓDIGO

P400716SA ○
P400716SB ○
P400716SC ○
P400716SD ○
P400716SE ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 0.7mm
H 1.5mm
H 3.0mm
H 4.5mm
H 6.0mm

CÓDIGO

P700716CA ●
P700716CB ●
P700716CC ●
P700716CD ●
P700716CE ●

CÓDIGO

P700716SA ○
P700716SB ○
P700716SC ○
P700716SD ○
P700716SE ○

20
N.cm

PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16HMD




Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

- » Medens®
- » Bio®
- » Systhex® Attract

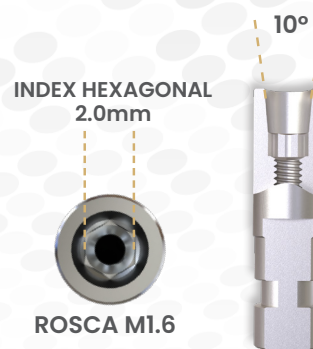

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO


D200716

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100716

PROVISÓRIO E CERÂMICA




PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

- H 0.7mm
- H 0.7mm
- H 1.5mm
- H 1.5mm
- H 3.0mm
- H 3.0mm
- H 4.5mm
- H 4.5mm

- P1716CSA ●
- P1716SSA ○
- P1716CSB ●
- P1716SSB ○
- P1716CSC ●
- P1716SSC ○
- P1716CSD ●
- P1716SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

- H 0.7mm
- H 0.7mm
- H 1.5mm
- H 1.5mm
- H 3.0mm
- H 3.0mm
- H 4.5mm
- H 4.5mm

- P1716CLA ●
- P1716SLA ○
- P1716CLB ●
- P1716SLB ○
- P1716CLC ●
- P1716SLC ○
- P1716CLD ●
- P1716SLD ○



Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

- » Medens®
- » Bio®
- » Systhex® Attract

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

10°



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 0.7mm	Reto
H 1.5mm	Reto
H 3.0mm	Reto
H 4.5mm	Reto
H 6.0mm	Reto

800716A	☐
800716B	☐
800716C	☐
800716D	☐
800716E	☐

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

- » Medens®
- » Bio®
- » Systhex® Attract

INDEX HEXAGONAL
2.0mm

ROSCA M1.6

10°



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO


T04000136

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

- » Medens®
- » Bio®
- » Systhex® Attract

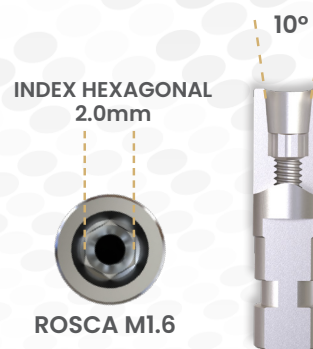

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO


D100005

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

- » Medens®
- » Bio®
- » Systhex® Attract

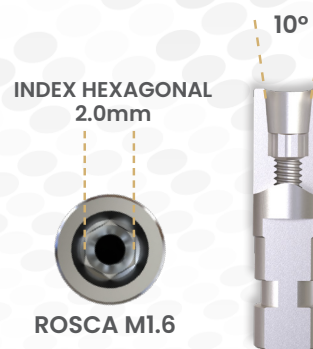

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

- P1005A ☐
- P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU




PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O'RING

CÓDIGO

- | | |
|---------|-------------------------------|
| H 0.7mm | 900716A ☐ |
| H 1.5mm | 900716B ☐ |
| H 3.0mm | 900716C ☐ |
| H 4.5mm | 900716D ☐ |
| H 6.0mm | 900716E ☐ |

SOLUÇÕES PARA
**PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
702

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem

INDEX HEXAGONAL
2.5mm



ROSCA M2.0

22°



COMPONENTES ANALÓGICOS



5.4mm

CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

300702B
300702C
300702D
300702E
300702F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200702A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200702B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100702




Cód.
702

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem

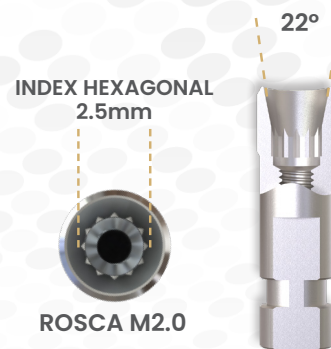

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 1.0mm

CÓDIGO

400702C



CÓDIGO

400702S



FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 1.0mm

CÓDIGO

700702C



CÓDIGO

700702S



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20HAT

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto
H 2mm	Reto
H 3mm	Reto
H 4mm	Reto
H 5mm	Reto
H 6mm	Reto

800702A	
800702B	
800702C	
800702D	
800702E	
800702F	



Cód.
702

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M2.0

22°



COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐




Cód.
702

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem

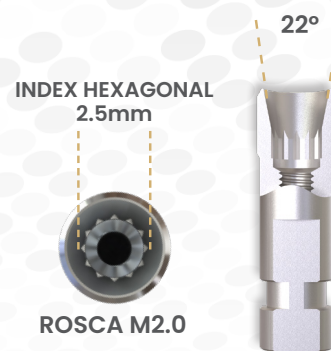

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO


T00800136

Cód.
702

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem

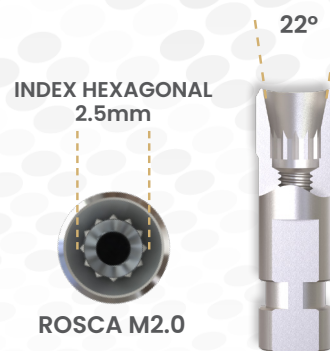

PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



MAIOR QUALIDADE E
PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M1.8

12°



COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

Ø3.9

CÓDIGO

Ø4.8

300801B

300802B

300801C

300802C

300801D

300802D

300801E

300802E

300801F

300802F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200801A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200801B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100801



Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO


» Mis® C1

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M1.8

12°

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

P400801CA ●
P400801CB ●
P400801CC ●
P400801CD ●

CÓDIGO

P400801SA ○
P400801SB ○
P400801SC ○
P400801SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

P700801CA ●
P700801CB ●
P700801CC ●
P700801CD ●

CÓDIGO

P700801SA ○
P700801SB ○
P700801SC ○
P700801SD ○

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

P500801A ●
P500801B ●
P500801C ●
P500801D ●

PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18HMI

20
N.cm



Cód.
801

Cone Morse 12°


UTILIZAÇÃO

» Mis® C1

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M1.8

12°



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200801




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100801

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm

P1801CSA

H 1mm

P1801SSA

H 2mm

P1801CSB

H 2mm


P1801SSB

H 3mm

P1801CSC

H 3mm

P1801SSC



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 1mm

P1801CLA

H 1mm

P1801SLA

H 2mm

P1801CLB

H 2mm

P1801SLB

H 3mm

P1801CLC

H 3mm

P1801SLC



Cód.
801

Cone Morse 12°


UTILIZAÇÃO

» Mis® C1

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M1.8

12°



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto
H 2mm	Reto
H 3mm	Reto
H 4mm	Reto
H 5mm	Reto
H 6mm	Reto

800801A	○
800801B	○
800801C	○
800801D	○
800801E	○
800801F	○

H 2mm	17°
H 3mm	17°
H 4mm	17°

80801BG	●
80801CG	●
80801DG	●

H 3mm	30°
H 4mm	30°

80801CH	●
80801DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M1.8

12°



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐



Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M1.8

12°

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E 

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1

INDEX HEXAGONAL
2.5mm

ROSCA M1.8

12°

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO


M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



LINHA COMPLETA **FLUXO DIGITAL**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Sistema Hexágono Externo




COMPONENTES

Confie e use!

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®

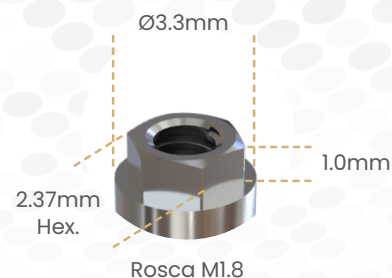

COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

- H 2mm
- H 3mm
- H 4mm
- H 5mm
- H 6mm

CÓDIGO

- 300102B
- 300102C
- 300102D
- 300102E
- 300102F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

- 200102A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

- 200102B




ANÁLOGO

CÓDIGO

- 100102

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®

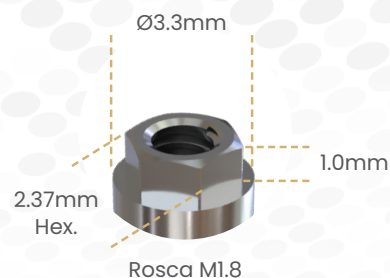

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

- P400102C 
P400102S 


FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

- P600102C 
P600102S 



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

- P700102C 
P700102S 



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18QU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M18DI




Cód.
102

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®

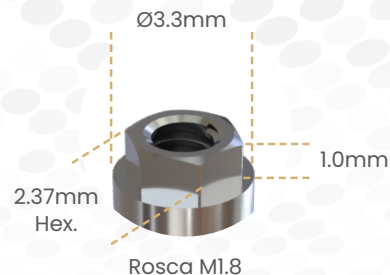

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO


D200102

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100102

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL


CÓDIGO

H 0.6mm

P1102CSA

H 0.6mm

P1102SSA



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.6mm

P1102CLA


H 0.6mm

P1102SLA



UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®

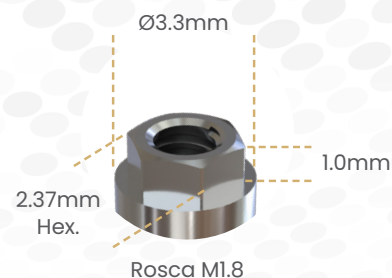

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800102A	○
H 2mm	Reto	800102B	○
H 3mm	Reto	800102C	○
H 4mm	Reto	800102D	○
H 5mm	Reto	800102E	○
H 6mm	Reto	800102F	○
H 2mm	17°	80102BG	●
H 3mm	17°	80102CG	●
H 4mm	17°	80102DG	●
H 3mm	30°	80102CH	●
H 4mm	30°	80102DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA


CÓDIGO

201005A



UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®

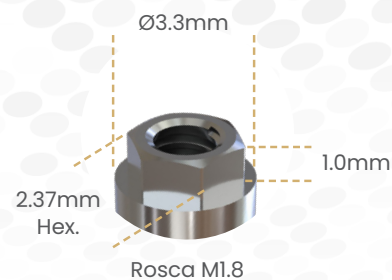

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐


UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

UTILIZAÇÃO

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| » Neodent® | » DentFix® | » Pross® |
| » BioConect® | » DSP® | » Restore® |
| » Bionnovation® | » Implus® | » Singular® |
| » Conexão® | » INP® | » Systhex® |

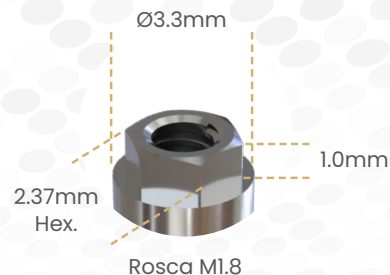

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO


CÓDIGO

M14DI



UTILIZAÇÃO

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| » Neodent® | » DentFix® | » Pross® |
| » BioConect® | » DSP® | » Restore® |
| » Bionnovation® | » Implus® | » Singular® |
| » Conexão® | » INP® | » Systhex® |

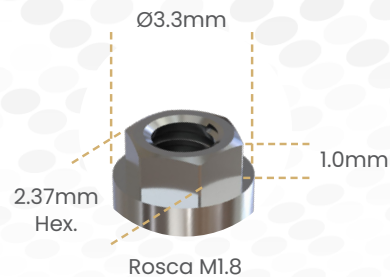

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐P1005AL ☐

PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO


CÓDIGO

M14DI



UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®

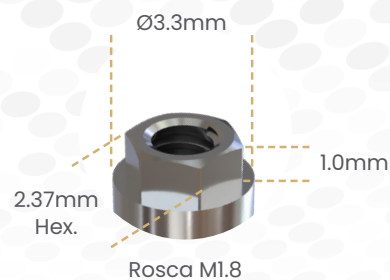

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O'RING

CÓDIGO

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

900102A ○
900102B ○
900102C ○
900102D ○
900102E ○
900102F ○

A MAIOR DIVERSIDADE
DE **COMPONENTES**
PARA **PRÓTESES**
SOBRE IMPLANTES
DO PAÍS



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES


Confie e use!

Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de Bortoli®
- » Signo Vincés® Inttegra / Duo / Ares Duo

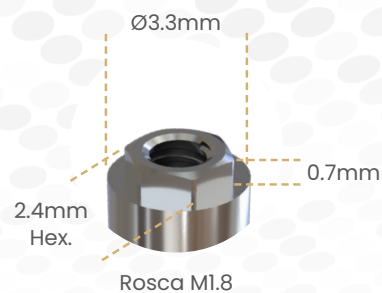

COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

300102B
300102C
300102D
300102E
300102F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200103A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200103B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100103




Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de Bortoli®
- » Signo Vincés® Inttegra / Duo / Ares Duo

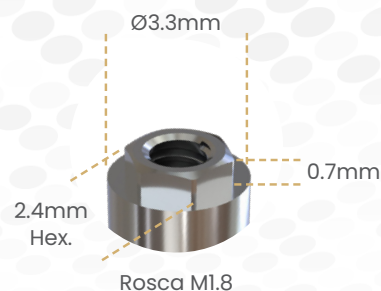

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

- P400103C 
P400103S 

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

- P600103C 
P600103S 



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

- P700103C 
P700103S 



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18QU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M18DI




Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de Bortoli®
- » Signo Vincés® Inttegra / Duo / Ares Duo

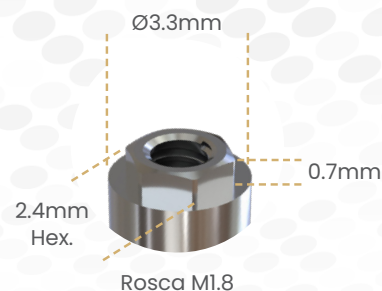

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800102A	○
H 2mm	Reto	800102B	○
H 3mm	Reto	800102C	○
H 4mm	Reto	800102D	○
H 5mm	Reto	800102E	○
H 6mm	Reto	800102F	○
H 2mm	17°	80103BG	●
H 3mm	17°	80103CG	●
H 4mm	17°	80103DG	●
H 3mm	30°	80103CH	●
H 4mm	30°	80103DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA


CÓDIGO

201005A




UTILIZAÇÃO

- » Implacil de Bortoli®
- » Signo Vincés® Integra / Duo / Ares Duo

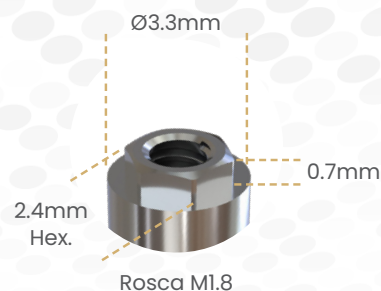**TRANSFER MOLDEIRA FECHADA****CÓDIGO****201005B****ANÁLOGO****CÓDIGO****101005****PROVISÓRIO****PILAR PROVISÓRIO****CÓDIGO****P401005** ☐**FUNDIÇÃO****COPING PLÁSTICO****CÓDIGO****P601005** ☐**UCLA BASE METÁLICA****CÓDIGO****P701005** ☐

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de Bortoli®
- » Signo Vincés® Inttegra / Duo / Ares Duo

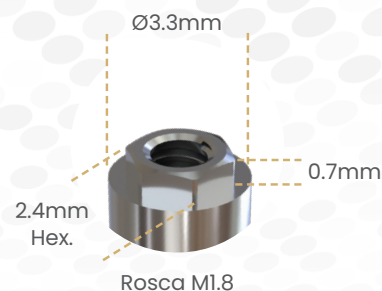
**PROTOCOLO SOLDADO****PILAR PARA SOLDA****CÓDIGO****P401005E** **Ø4mm****BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM****CÓDIGO****T04000136****Ø3.18mm****BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM****CÓDIGO****T03180136****Ø0.8mm****FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM****CÓDIGO****T00800136****PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)****CÓDIGO****M14MU****PARAFUSO DINÂMICO****CÓDIGO****M14DI**

Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de Bortoli®
- » Signo Vincés® Inttegra / Duo / Ares Duo

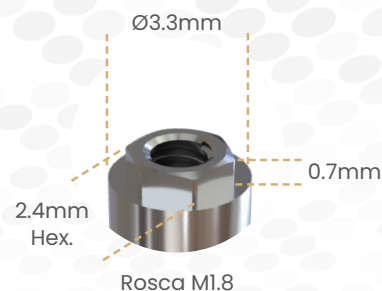

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐
P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O´RING


CÓDIGO

H 1mm	900102A ☐
H 2mm	900102B ☐
H 3mm	900102C ☐
H 4mm	900102D ☐
H 5mm	900102E ☐
H 6mm	900102F ☐


LEGENDA



Hexagonal



Dinâmica



Rotacional



SOLUÇÕES PARA
**PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES


Confie e use!

Cód.
104

HE 3.25/3.4

UTILIZAÇÃO

- » 3i®
- » SIN®
- » IntraOss®

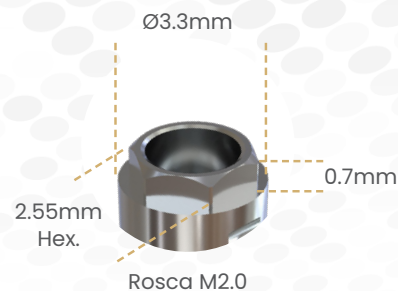

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO


D200104

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100104

PROVISÓRIO E CERÂMICA



4mm

PILAR INTERFACE SEM PERFIL


CÓDIGO

H 0.6 mm

P1104CSA

H 0.6 mm

P1104SSA



5mm

PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.6 mm

P1104CLA

H 0.6 mm

P1104SLA



32
N.cm

PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20QU



32
N.cm

PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M20DI

LEGENDA



Quadrado



Dinâmica



Rotacional



Antirrotacional



MAIOR QUALIDADE E
PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)




COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®

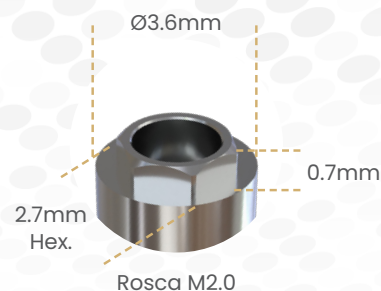

COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

300108B
300108C
300108D
300108E
300108F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200108A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200108B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100108




Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®

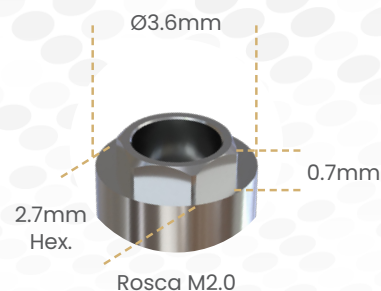

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

- P400108C 
P400108S 

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

- P600108C 
P600108S 



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

- P700108C 
P700108S 



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20QU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M20DI




Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®

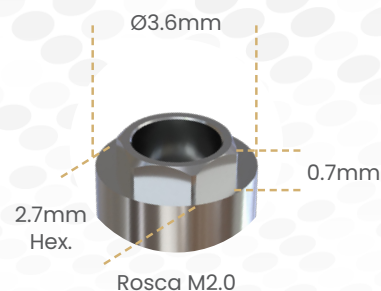

PRÓTESE MÚLTIPLA




MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto
H 2mm	Reto
H 3mm	Reto
H 4mm	Reto
H 5mm	Reto
H 6mm	Reto

800108A	○
800108B	○
800108C	○
800108D	○
800108E	○
800108F	○



H 2mm	17°
H 3mm	17°
H 4mm	17°

80108BG	●
80108CG	●
80108DG	●

H 3mm	30°
H 4mm	30°

80108CH	●
80108DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A




Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®

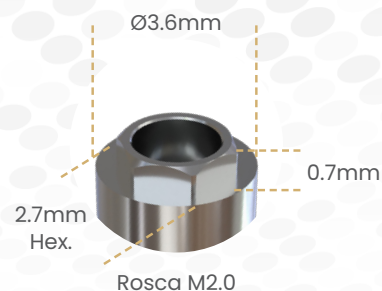

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐




Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » SIN®
- » Dentoflex®
- » Titanium Fix®
- » Implalife®
- » Medens®

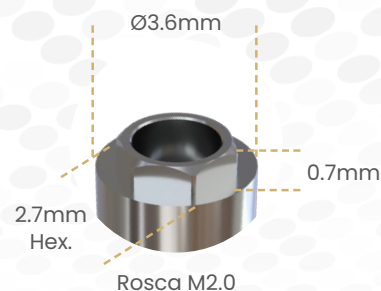

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E 

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI




Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » SIN®
- » Dentoflex®
- » Titanium Fix®
- » Implalife®
- » Medens®

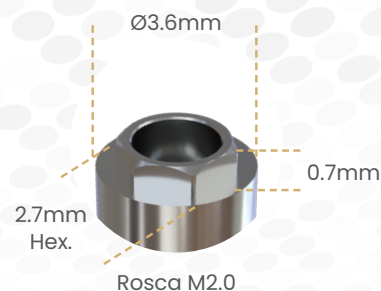

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU




PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI





LINHA COMPLETA **FLUXO DIGITAL**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES


Confie e use!

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum
entre todas as marcas de implante

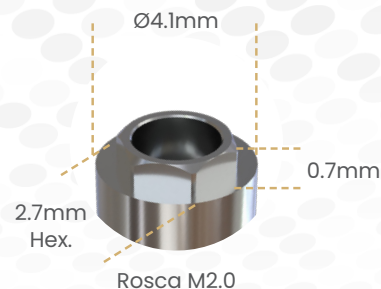

COMPONENTES ANALÓGICOS



4.95mm



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301105

CICATRIZADOR

CÓDIGO

H 2mm

300105B

H 3mm

300105C

H 4mm

300105D

H 5mm

300105E

H 6mm

300105F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200105A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200105B



ANÁLOGO

CÓDIGO

100105




Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum
entre todas as marcas de implante

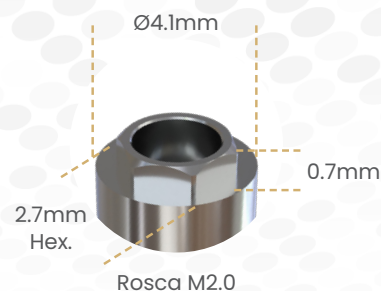

PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P400105C 
P400105S 

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

P600105C 
P600105S 



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P700105C 
P700105S 

UNITÁRIA CIMENTADA



PILAR DEFINITIVO

CÓDIGO

H 1mm	P500105A 
H 2mm	P500105B 
H 3mm	P500105C 
H 4mm	P500105D 




Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal


UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum
entre todas as marcas de implante

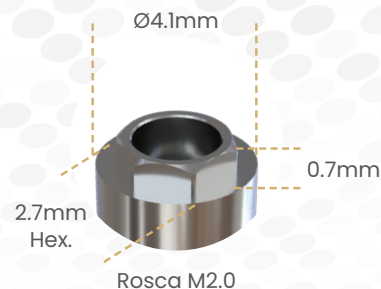

PILAR DEFINITIVO

CÓDIGO

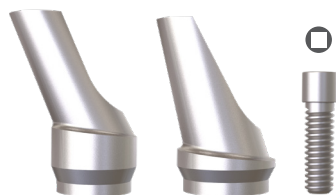

H 1mm 15°
H 2mm 15°
H 3mm 15°

P50105AG ●
P50105BG ●
P50105CG ●

H 1mm 25°
H 2mm 25°
H 3mm 25°

P50105AH ●
P50105BH ●
P50105CH ●



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20QU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M20DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200105



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100105




Cód.
105


HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum
entre todas as marcas de implante

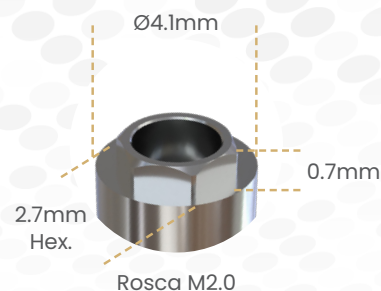

PROVISÓRIO E CERÂMICA




PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 0.6 mm
H 0.6 mm
H 1.5 mm
H 1.5 mm

P1105CSA ●
P1105SSA ○
P1105CSB ●
P1105SSB ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.6 mm
H 0.6 mm
H 1.5 mm
H 1.5 mm

P1105CLA ●
P1105SLA ○
P1105CLB ●
P1105SLB ○

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm Reto
H 2mm Reto
H 3mm Reto
H 4mm Reto
H 5mm Reto
H 6mm Reto

800105A ○
800105B ○
800105C ○
800105D ○
800105E ○
800105F ○

H 2mm 17°
H 3mm 17°
H 4mm 17°

80105BG ●
80105CG ●
80105DG ●

H 3mm 30°
H 4mm 30°

80105CH ●
80105DH ●




Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum
entre todas as marcas de implante

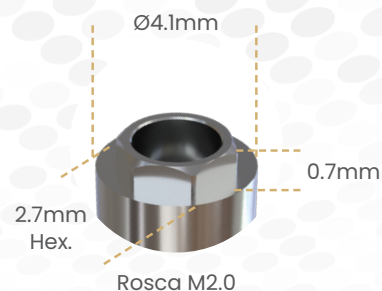

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐




Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum
entre todas as marcas de implante

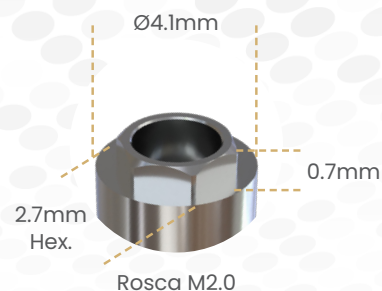

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ☐

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136




Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum
entre todas as marcas de implante

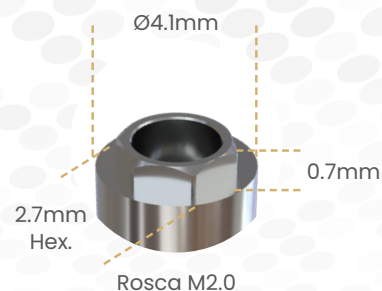

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO


D100005

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante

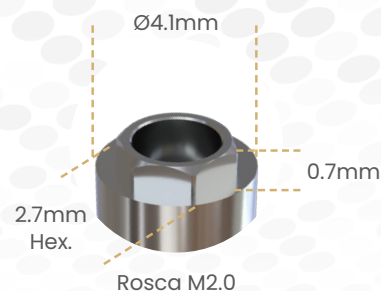

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐
P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O-RING

CÓDIGO

H 1mm	900105A ☐
H 2mm	900105B ☐
H 3mm	900105C ☐
H 4mm	900105D ☐
H 5mm	900105E ☐
H 6mm	900105F ☐

A **MAIOR** DIVERSIDADE
DE **COMPONENTES**
PARA **PRÓTESES**
SOBRE IMPLANTES
DO PAÍS



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)




COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
110

HE 5.0

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » Bio Implantes®
- » Systhex®
- » Signo Vincés®
- » INP®

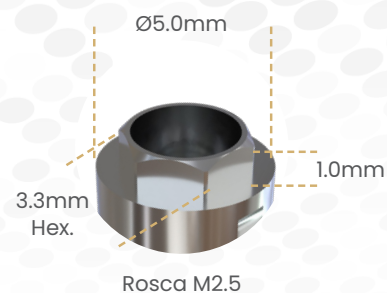

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO


D200110

ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100110

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.6 mm

P1110CSA

H 0.6 mm

P1110SSA



PARAFUSO

CÓDIGO

M25QU

SOLUÇÕES PARA
**PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

Sistema Hexágono Interno



COMPONENTES


Confie e use!

Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

- » Conexão®
- » IntraOss®
- » SIN®
- » Systhex®



COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

300307B
300307C
300307D
300307E
300307F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200316A

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO


200316B

ANÁLOGO

CÓDIGO

100316

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P400316C ●
P400316S ○




Cód.
316


3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

- » Conexão®
- » IntraOss®
- » SIN®
- » Systhex®



FUNDIÇÃO




UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

P600316C

P600316S



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P700316C

P700316S



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18QCN

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200316



ANÁLOGO DIGITAL



CÓDIGO

D100316




UTILIZAÇÃO

- » Conexão®
- » IntraOss®
- » SIN®
- » Systhex®

**PROVISÓRIO E CERÂMICA****PILAR INTERFACE SEM PERFIL****CÓDIGO**

H 1.0 mm
H 1.0 mm
H 2.0 mm
H 2.0 mm
H 3.0 mm
H 3.0 mm

P1316CSA ●
P1316SSA ○
P1316CSB ●
P1316SSB ○
P1316CSC ●
P1316SSC ○

**PILAR INTERFACE COM PERFIL****CÓDIGO**

H 1.0 mm
H 1.0 mm
H 2.0 mm
H 2.0 mm
H 3.0 mm
H 3.0 mm

P1316CLA ●
P1316SLA ○
P1316CLB ●
P1316SLB ○
P1316CLC ●
P1316SLC ○

PRÓTESE MÚLTIPLA**MINI PILAR CÔNICO****CÓDIGO**

H 1mm Reto
H 2mm Reto
H 3mm Reto
H 4mm Reto
H 5mm Reto
H 6mm Reto

800316A ○
800316B ○
800316C ○
800316D ○
800316E ○
800316F ○



H 2mm 17°
H 3mm 17°
H 4mm 17°

80316BG ●
80316CG ●
80316DG ●

H 3mm 30°
H 4mm 30°

80316CH ●
80316DH ●




Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

- » Conexão®
- » IntraOss®
- » SIN®
- » Systhex®



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐




Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

- » Conexão®
- » IntraOss®
- » SIN®
- » Systhex®



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E

Ø4mm




BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO


M14DI

Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

- » Conexão®
- » IntraOss®
- » SIN®
- » Systhex®



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O´RING

CÓDIGO

H 1mm

900316A ☐

H 2mm

900316B ☐

H 3mm

900316C ☐

H 4mm

900316D ☐

H 5mm

900316E ☐

H 6mm

900316F ☐

MAIOR QUALIDADE E
PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)




COMPONENTES

Confie e use!

Cód.
204 **3.5 A 5.0**

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



2.5mm
Hex.

Rosca M2.0

COMPONENTES ANALÓGICOS



4.6mm

CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

300204B
300204C
300204D
300204E
300204F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200204A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200204B



ANÁLOGO


CÓDIGO

100204




UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P400204C

P400204S

FUNDIÇÃO




UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

P600204C

P600204S



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P700204C

P700204S



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M20QU




PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M20DI

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto
H 2mm	Reto
H 3mm	Reto
H 4mm	Reto
H 5mm	Reto
H 6mm	Reto

800204A	○
800204B	○
800204C	○
800204D	○
800204E	○
800204F	○



H 2mm	17°
H 3mm	17°
H 4mm	17°

80204BG	●
80204CG	●
80204DG	●

H 3mm	30°
H 4mm	30°

80204CH	●
80204DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA


CÓDIGO

201005B



UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA


CÓDIGO

P401005E ☐



UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL


CÓDIGO

D200005

Cód.
204 **3.5 A 5.0**

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ○

P1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR O´RING

CÓDIGO

H 1mm

900204A ○

H 2mm

900204B ○

H 3mm

900204C ○

H 4mm


900204D ○

H 5mm

900204E ○

H 6mm

900204F ○



LINHA COMPLETA

FLUXO

DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES


Confie e use!

Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus

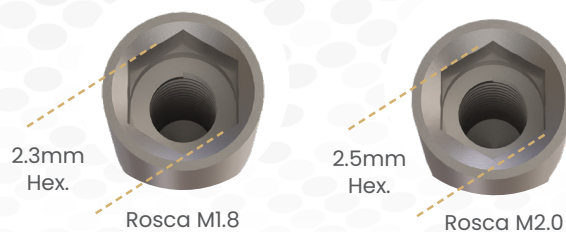

COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO
HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

300208B
300208C
300208D
300208E
300208F

CÓDIGO
HI 3.75 até 5.0

300209B
300209C
300209D
300209E
300209F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO
HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

200208A

CÓDIGO
HI 3.75 até 5.0

200209A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO
HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

200208B

CÓDIGO
HI 3.75 até 5.0

200209B



ANÁLOGO

CÓDIGO
HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

100208

CÓDIGO
HI 3.75 até 5.0

100209




Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus

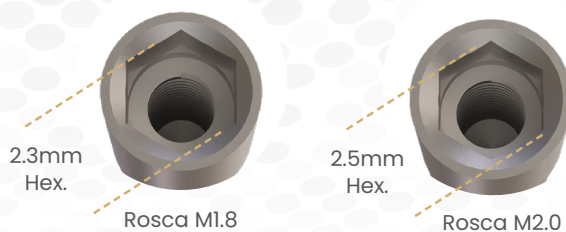


PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO


CÓDIGO	CÓDIGO
HI 3.3/3.5	HI 3.75 até 5.0
HI Maestro 3.4/4.0/5.0	
P400208C ●	P400209C ●
P400208S ○	P400209S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO	CÓDIGO
HI 3.3/3.5	HI 3.75 até 5.0
HI Maestro 3.4/4.0/5.0	
P600208C ●	P600209C ●
P600208S ○	P600209S ○



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO	CÓDIGO
HI 3.3/3.5	HI 3.75 até 5.0
HI Maestro 3.4/4.0/5.0	
P700208C ●	P700209C ●
P700208S ○	P700209S ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)

CÓDIGO	CÓDIGO
HI 3.3/3.5	HI 3.75 até 5.0
HI Maestro 3.4/4.0/5.0	
M18QU ○	M20QU ○
20 N.cm	32 N.cm



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO	CÓDIGO
HI 3.3/3.5	HI 3.75 até 5.0
HI Maestro 3.4/4.0/5.0	
M18DI ●	M20DI ●
20 N.cm	32 N.cm

LEGENDA

- Quadrado
- Dinâmica
- Rotacional
- Antirrotacional




Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus

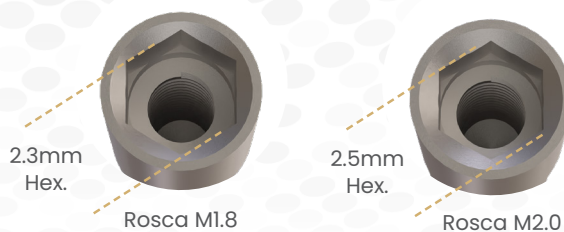

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

D200208

CÓDIGO

HI 3.75 até 5.0

D200209



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0


D100208

CÓDIGO

HI 3.75 até 5.0

D100209

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

H 0.6mm

H 0.6mm

H 1.5mm

H 1.5mm

CÓDIGO

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

P1208CSA ●

P1208SSA ○

P1208CSB ●

P1208SSB ○

CÓDIGO


HI 3.75 até 5.0

P1209CSA ●

P1209SSA ○

P1209CSB ●

P1209SSB ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

H 0.6mm

H 0.6mm

H 1.5mm

H 1.5mm

CÓDIGO

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

P1208CLA ●

P1208SLA ○

P1208CLB ●

P1208SLB ○

CÓDIGO

HI 3.75 até 5.0

P1209CLA ●

P1209SLA ○

P1209CLB ●



P1209SLB ○

Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus



PRÓTESE TIPO PROTOCOLO



MINIPILAR CÔNICO		CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
H 1mm	Reto	800208A ○	800209A ○
H 2mm	Reto	800208B ○	800209B ○
H 3mm	Reto	800208C ○	800209C ○
H 4mm	Reto	800208D ○	800209D ○
H 5mm	Reto	800208E ○	800209E ○
H 6mm	Reto	800208F ○	800209F ○
H 2mm	17°	80208BG ●	80209BG ●
H 3mm	17°	80208CG ●	80209CG ●
H 4mm	17°	80208DG ●	80209DG ●
H 3mm	30°	80208CH ●	80209CH ●
H 4mm	30°	80208DH ●	80209DH ●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A





Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO



P701005 ☐

Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus



PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ○

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI





Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO



M14DI

Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

- » Implacil de bortoli®
- » INP® Conus



SISTEMA OVERDENTURE

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 225



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

H 1mm
H 2mm
H 3mm
H 4mm

CÓDIGO

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.4/4.0/5.0

CÓDIGO

HI 3.75 até 5.0

900208A ○
900208B ○
900208C ○
900208D ○

900209A ○
900209B ○
900209C ○
900209D ○



A **MAIOR** DIVERSIDADE
DE **COMPONENTES**
PARA **PRÓTESES**
SOBRE IMPLANTES
DO PAÍS



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)




COMPONENTES
Confie e use!

Cód.
799

3.3

UTILIZAÇÃO

» MIS®



COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

CÓDIGO

300799B
300799C
300799D
300799E
300799F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200799A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200799B



ANÁLOGO

CÓDIGO


100799



Cód.
799 **3.3**

UTILIZAÇÃO

» MIS®



FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P700799C 

P700799S 



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M16HMI

COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200799

ANÁLOGO DIGITAL



CÓDIGO

D100799




UTILIZAÇÃO

» MIS®

**PROVISÓRIO E CERÂMICA****PILAR INTERFACE SEM PERFIL****CÓDIGO**

H 0.5 mm
H 0.5 mm
H 1.5 mm
H 1.5 mm
H 3.0 mm
H 3.0 mm

P1799CSA ●
P1799SSA ○
P1799CSB ●
P1799SSB ○
P1799CSC ●
P1799SSC ○

**PILAR INTERFACE COM PERFIL****CÓDIGO**

H 0.5 mm
H 0.5 mm
H 1.5 mm
H 1.5 mm
H 3.0 mm
H 3.0 mm

P1799CLA ●
P1799SLA ○
P1799CLB ●
P1799SLB ○
P1799CLC ●
P1799SLC ○

PRÓTESE MÚLTIPLA**MINI PILAR CÔNICO****CÓDIGO**


H 1mm Reto
H 2mm Reto
H 3mm Reto
H 4mm Reto
H 5mm Reto
H 6mm Reto

800799A ○
800799B ○
800799C ○
800799D ○
800799E ○
800799F ○



UTILIZAÇÃO

» MIS®



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO


CÓDIGO

P401005 ○




UTILIZAÇÃO

» MIS®

**FUNDIÇÃO****COPING PLÁSTICO****CÓDIGO****P601005** ☐**UCLA BASE METÁLICA****CÓDIGO****P701005** ☐**PROTOCOLO SOLDADO****PILAR PARA SOLDA****CÓDIGO****P401005E** ☐**Ø4mm****BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM****CÓDIGO****T04000136****Ø3.18mm****BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM****CÓDIGO****T03180136****Ø0.8mm****FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM****CÓDIGO****T00800136**

UTILIZAÇÃO

» MIS®

**PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)****CÓDIGO****M14MU****PARAFUSO DINÂMICO****CÓDIGO****M14DI****COMPONENTES DIGITAIS****TRANSFER DIGITAL****CÓDIGO****D200005****ANÁLOGO DIGITAL****CÓDIGO****D100005****PROVISÓRIO E CERÂMICA****PILAR INTERFACE****CÓDIGO****P1005A** ☐**P1005AL** ☐**PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)****CÓDIGO****M14MU****PARAFUSO DINÂMICO****CÓDIGO****M14DI**

SOLUÇÕES PARA
**PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)




COMPONENTES


Confie e use!

UTILIZAÇÃO

- » MIS® Seven
- » DSP®



COMPONENTES ANALÓGICOS



CICATRIZADOR

- H 2mm
- H 3mm
- H 4mm
- H 5mm
- H 6mm

CÓDIGO

Ø4.0

CÓDIGO

Ø4.8

- | | |
|---------|---------|
| 300800B | 300803B |
| 300800C | 300803C |
| 300800D | 300803D |
| 300800E | 300803E |
| 300800F | 300803F |

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CÓDIGO

200800A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

200800B




ANÁLOGO

CÓDIGO


100800

UTILIZAÇÃO

- » MIS® Seven
- » DSP®



PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

- P400800C ●
P400800S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

- P600800C ●
P600800S ○



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

H 1.2mm
H 1.2mm

- P700800C ●
P700800S ○




PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18HMI

UTILIZAÇÃO

- » MIS® Seven
- » DSP®



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200800




ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100800

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL

CÓDIGO

H 0.5 mm

P1800CSA ●

H 0.5 mm

P1800SSA ○

H 1.5 mm

P1800CSB ●

H 1.5 mm


P1800SSB ○

H 3.0 mm

P1800CSC ●

H 3.0 mm

P1800SSC ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL

CÓDIGO

H 0.5 mm

P1800CLA ●

H 0.5 mm

P1800SLA ○

H 1.5 mm

P1800CLB ●

H 1.5 mm

P1800SLB ○

H 3.0 mm

P1800CLC ●


H 3.0 mm

P1800SLC ○




UTILIZAÇÃO

- » MIS® Seven
- » DSP®



PRÓTESE MÚLTIPLA

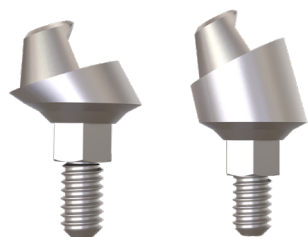

MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800800A	○
H 2mm	Reto	800800B	○
H 3mm	Reto	800800C	○
H 4mm	Reto	800800D	○
H 5mm	Reto	800800E	○
H 6mm	Reto	800800F	○
H 2mm	17°	80800BG	●
H 3mm	17°	80800CG	●
H 4mm	17°	80800DG	●
H 3mm	30°	80800CH	●
H 4mm	30°	80800DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA


CÓDIGO

201005A



UTILIZAÇÃO

- » MIS® Seven
- » DSP®



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

CÓDIGO

201005B



ANÁLOGO

CÓDIGO

101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P401005 ☐

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO

CÓDIGO

P601005 ☐




UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P701005 ☐

UTILIZAÇÃO

- » MIS® Seven
- » DSP®



PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA

CÓDIGO

P401005E ○

Ø4mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM

CÓDIGO

T04000136

Ø3.18mm



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM

CÓDIGO

T03180136

Ø0.8mm



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM

CÓDIGO

T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO


M14DI

Cód.
800

3.7 / 4.2

UTILIZAÇÃO

- » MIS® Seven
- » DSP®



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐

P1005AL ☐



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI

MAIOR QUALIDADE E
PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR




[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES
Confie e use!

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®

**COMPONENTES ANALÓGICOS**

4.80mm

CICATRIZADOR**CÓDIGO**

H 2mm
H 3mm
H 4mm
H 5mm
H 6mm

300113B
300113C
300113D
300113E
300113F

PARAFUSADA DIRETA NO IMPLANTE**TRANSFER MOLDEIRA ABERTA****CÓDIGO**

200113A

**TRANSFER MOLDEIRA FECHADA****CÓDIGO**

200113B

**ANÁLOGO****CÓDIGO**


100113

Cód.
113


3.75 / 4.0 / 5.0

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®



PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO

CÓDIGO

P400113C

P400113S

FUNDIÇÃO




UCLA PLÁSTICA

CÓDIGO

P600113C

P600113S



UCLA BASE METÁLICA

CÓDIGO

P700113C

P700113S



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO

M18QU



PARAFUSO DINÂMICO


CÓDIGO

M18DI

Cód.
113**3.75 / 4.0 / 5.0**

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®



PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR CÔNICO

CÓDIGO

H 1mm	Reto	800113A	○
H 2mm	Reto	800113B	○
H 3mm	Reto	800113C	○
H 4mm	Reto	800113D	○
H 5mm	Reto	800113E	○
H 6mm	Reto	800113F	○
H 2mm	17°	80113BG	●
H 3mm	17°	80113CG	●
H 4mm	17°	80113DG	●
H 3mm	30°	80113CH	●
H 4mm	30°	80113DH	●

COMPONENTES SOBRE O MINI PILAR



TAMPA DE PROTEÇÃO

CÓDIGO

301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA


CÓDIGO

201005A



UTILIZAÇÃO


» Titanium Fix®

**TRANSFER MOLDEIRA FECHADA****CÓDIGO****201005B****ANÁLOGO****CÓDIGO****101005****PROVISÓRIO****PILAR PROVISÓRIO****CÓDIGO****P401005** ☐**FUNDIÇÃO****COPING PLÁSTICO****CÓDIGO****P601005** ☐**UCLA BASE METÁLICA****CÓDIGO****P701005** ☐

Cód.
113**3.75 / 4.0 / 5.0**

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®




PROTOCOLO SOLDADO

**PILAR PARA SOLDA****CÓDIGO****P401005E** **Ø4mm****BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM****CÓDIGO****T04000136****Ø3.18mm****BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM****CÓDIGO****T03180136****Ø0.8mm****FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM****CÓDIGO****T00800136****PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)****CÓDIGO****M14MU****PARAFUSO DINÂMICO****CÓDIGO****M14DI**

Cód.
113**3.75 / 4.0 / 5.0**

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®



COMPONENTES DIGITAIS



TRANSFER DIGITAL

CÓDIGO

D200005



ANÁLOGO DIGITAL

CÓDIGO

D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE

CÓDIGO

P1005A ☐P1005AL ☐

PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)

CÓDIGO


M14MU



PARAFUSO DINÂMICO

CÓDIGO

M14DI



LINHA COMPLETA **FLUXO DIGITAL**



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

OVERDENTURE

UTILIZAÇÃO

» Componentes sobre pilar o íring

COMPONENTES PARA MUCOSSUPOORTADAS



O'RING CALCINÁVEL

CÓDIGO

804105



ANEL CALCINÁVEL

CÓDIGO

805105



BARRA CALCINÁVEL

CÓDIGO

BARRA



CLIP PARA OVERDENTURE

CÓDIGO

CLIPTEC



CLIP 0°

CÓDIGO

CLIP0



CLIP 35°

CÓDIGO

CLIP35



CLIP 70°

CÓDIGO

CLIP70

OVERDENTURE

UTILIZAÇÃO

» Componentes sobre pilar o ´ring

COMPONENTES PARA MUCOSSUPORTADAS



CÁPSULA METÁLICA O´RING

CÓDIGO

802105



CÁPSULA METÁLICA O´RING MINI

CÓDIGO

802105M



ANEL O´RING PARA CÁPSULA METÁLICA

CÓDIGO

ORING2



ANEL O´RING PARA CÁPSULA METÁLICA MINI

CÓDIGO

ORING3



CÁPSULA PLÁSTICA

CÓDIGO

803105





UCLAFIX


CÓDIGO

701006

UTILIZAÇÃO

A UclaFix é um componente protético que permite reabilitar com sucesso casos onde o parafuso sairia por vestibular ou incisal, através da fixação do coping sobre o pilar personalizado, substituindo assim a cimentação.





Portanto, em casos críticos, devido a posição desfavorável do implante, a UclaFix trará uma solução estética e funcional.

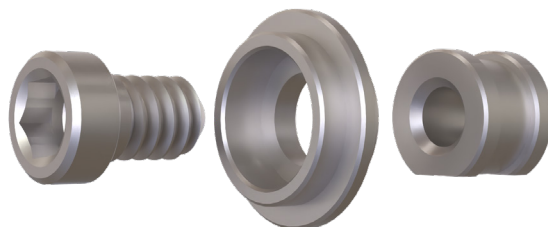

CHAVE DIGITAL



CHAVE DIGITAL

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
	CURTA	MÉDIA	LONGA	EXTRA LONGA
 Fenda	CDFC	-----	CDFL	-----
 Hexagonal 0.9mm	CDH09C	CDH09M	CDH09L	-----
 Hexagonal 1.2mm	CDH12C	CDH12M	CDH12L	CDH12EL
 Quadrada 1.3mm	CDQ13C	CDQ13M	CDQ13L	CDQ13EL
 GM	CDGMC	CDGMM	CDGML	CDGMEL
 Torx	CDSTC	CDSTM	CDSTL	CDSTEL
 Unigrip	CDUGC	CDUGM	CDUGL	CDUGEL
 Dinâmica	CDDIC	CDDIM	CDDIL	-----

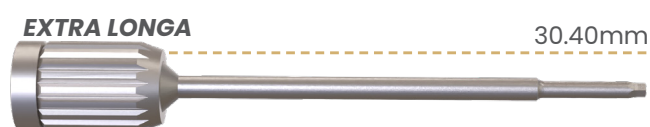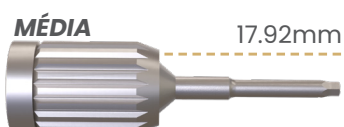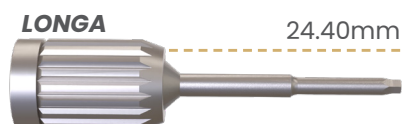

CHAVE DIGITAL MULT UNIT



CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
CURTA	MÉDIA	LONGA	EXTRA LONGA
CDMUC	CDMUM	CDMUL	-----

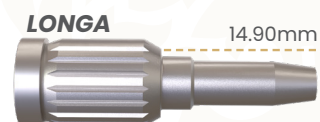

CHAVE TORQUÍMETRO


CHAVE TORQUÍMETRO

	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
	CURTA	MÉDIA	LONGA	EXTRA LONGA
 Hexagonal 0.9mm	CTH09C	CTH09M	CTH09L	-----
 Hexagonal 1.2mm	CTH12C	CTH12M	CTH12L	CTH12EL
 Hexagonal 1.6mm	CTH16C	CTH16M	CTH16L	-----
 Quadrada. 1.3mm	CTQ13C	CTQ13M	CTQ13L	CTQ13EL
 GM	CTGMC	CTGMM	CTGML	CTGMEL
 Torx	CTSTC	CTSTM	CTSTL	CTSTEL
 Unigrip	CTUGC	CTUGM	CTUGL	-----
 Dinâmica	CTDIC	CTDIM	CTDIL	-----



CHAVE TORQUÍMETRO MULT UNIT

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
CURTA	MÉDIA	LONGA	EXTRA LONGA
CTMUC	CTMUM	CTMUL	-----



OUTROS INSTRUMENTAIS



ADAPTADOR DIGITAL QUADRADO

CÓDIGO

ADQCT



SACA IMPLANTE

CÓDIGO

SIMP



TORQUÍMETRO 10 A 80 NCM

CÓDIGO

TORQ

A MAIOR DIVERSIDADE
DE **COMPONENTES**
PARA **PRÓTESES**
SOBRE IMPLANTES
DO PAÍS



RPCOMPONENTES.COM.BR



[@RPCOMPONENTES](https://www.instagram.com/RPCOMPONENTES)



COMPONENTES

Confie e use!

KIT DE CHAVES

KIT DE CHAVES MULTIMARCAS



	CÓDIGO
Estojo Kit Chaves	EKC
 Chave Torquímetro Hexagonal 0.9mm Média	CTH09M
 Chave Torquímetro Hexagonal 1.2mm Média	CTH12M
 Chave Torquímetro Quadrada 1.3mm Média	CTQ13M
 Chave Torquímetro Hexagonal 1.6mm Média	CTH16M
 Chave Torquímetro Torx Média	CTSTM
 Chave Torquímetro Unigrip Média	CTUGM
 Chave Torquímetro DI Média	CTDIM
Chave Torquímetro p/ Multi-Unit Média	CTMUM
Adaptador Digital Quadrado para Chave de torquímetro	ADQCT

KIT PROTÉTICO PLUS



CÓDIGO

Estojo Kit Protético Plus

- ⊗ Chave Torquímetro Hexagonal 0.9mm Média
- ⊗ Chave Torquímetro Hexagonal 1.2mm Média
- ⊗ Chave Torquímetro Quadrada 1.3mm Média
- ⊗ Chave Digital Hexagonal 1.2mm Extra Longa
- ⊗ Chave Torquímetro Hexagonal 1.6mm Média
- ⊗ Chave Torquímetro Torx Média
- ⊗ Chave Torquímetro Unigrip Média
- ⊗ Chave Torquímetro DI Média
- Chave Torquímetro p/ Multi-Unit Média
- Adaptador Digital Quadrado para Chave de Torquímetro
- Torquímetro 10 a 80N.cm

EKPP

CTH09M

CTH12M

CTQ13M

CDH12EL

CTH16M

CTSTM

CTUGM

CTDIM

CTMUM

ADQCT

TORQ

IDENTIFICAÇÃO

KIT DE IDENTIFICAÇÃO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Análogo Digital RN 4.0 ST	D100730	Transfer Digital RN 3.3-4.1-4.8 ST	D200730
Análogo Digital CM 4.3-5.0 RP NB	D100321	Transfer Digital CM 4.3-5.0 RP NB	D200321
Análogo Digital CM 3.5, 4.3 e 5.0 ND	D100703	Transfer Digital CM 3.5-3.9-4.2-4.3-5.0 C1-V3 MI	D200801
Análogo Digital CM 3.5, 4.3 e 5.0 DB	D100714	Transfer Digital CM 3.5-3.75-4.0-4.3-5.0 ND	D200703
Análogo Digital CM 3.5, 3.75 e 4.0 CN	D100705	Transfer Digital CM 3.5-4.0-4.5-5.0 DB	D200714
Análogo Digital CM 3.5 e 4.0 AT	D100701	Transfer Digital CM 3.5-3.75-4.0-4.3-5.0 CN	D200705
Análogo Digital CM 3.5, 4.3 e 5.0 GM ND	D100720	Transfer Digital CM 3.5-4.0 AT	D200701
Análogo Digital CM 3.8, 4.5 e 5.5 SI	D100712	Transfer Digital CM 3.5-3.75-4.0-4.3-5.0 GM ND	D200720
Análogo Digital RC 4.1 ST	D100755	Transfer Digital CM 3.5-3.8-4.5-5.0 SI	D200712
Análogo Digital NC 3.3 ST	D100750	Transfer Digital RC 4.1-4.8 ST	D200755
Análogo Digital CM 3.75	D100790	Transfer Digital NC 3.3 ST	D200750
		Transfer Digital RB-WB 3.5 a 6.5 ST	D200790

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Chave M2.0 Para Remoção do Análogo	CH20IRAD
Chave M1.8 Para Remoção do Análogo	CH18IRAD
Chave M1.6 Para Remoção do Análogo	CH16IRAD
Chave M1.4 Para Remoção do Análogo	CH14IRAD

KIT RP PARA CONVERSÃO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
Mandril para Brocas	MPBRPC	1
Broca Piloto	BPRPC	1
Broca Perfuração de Acesso	BPARPC	1
Broca de Limpeza	BLRPC	1
Chave Digital Hexagonal 1.2mm Para Conversão	CDH12PC	1
Chave de Recuperação do Pino Roscado	CRPR	1
Interface Longo RPC	1012L	12
Parafuso M1.4 Separável Longo Hex. 1.2	M14SLH	12
Parafuso M1.4 Hexagonal MU	M14MU	12
Análogo do Scan Kit 4.8 MU	D10005SK	6

20 anos de precisão em componentes para prótese sobre implante.



COMPONENTES
Confie e use!



ESTAMOS SEMPRE À DISPOSIÇÃO,
ENTRE EM CONTATO E TIRE SUAS DÚVIDAS.



RUA DANILO VALBUZA, 333 - LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP - BRASIL - CEP. 07747-300
+55 11 4441.3854